

# 精度測定検査表

Examination for precision list

測定日

2013. 8. 1

精度評価

コメント

A 0 ~ 0.02mm

**B** 0 ~ 0.03mm

C 0 ~ 0.04mm


D 0 ~ 0.05mm

精度良好


メーカー 北村 パーコード P2358

型式 Mycenter-2XiF

## 振り回し(300ピッチ)

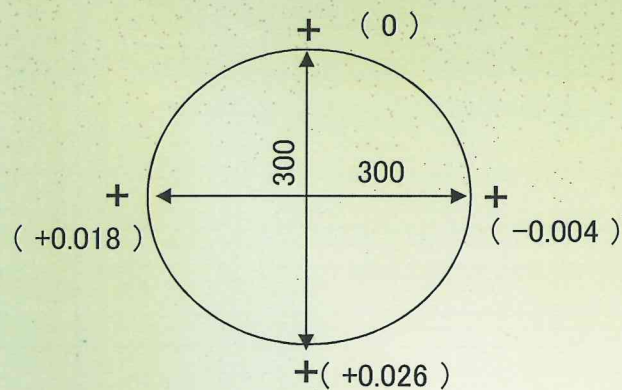


## 主軸振れ

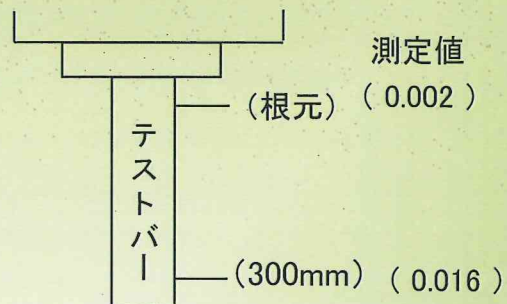


## 直角度


【YZ】

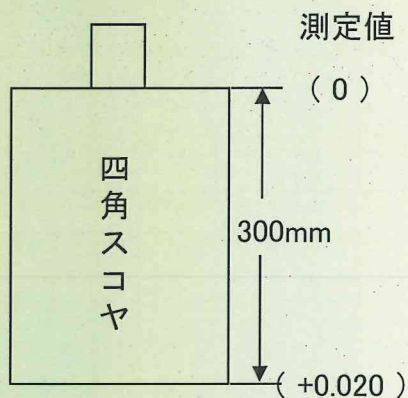

【XZ】

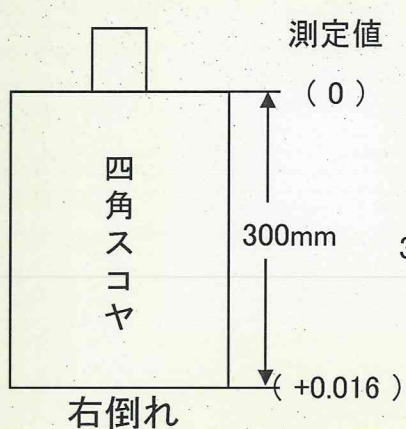

【XY】

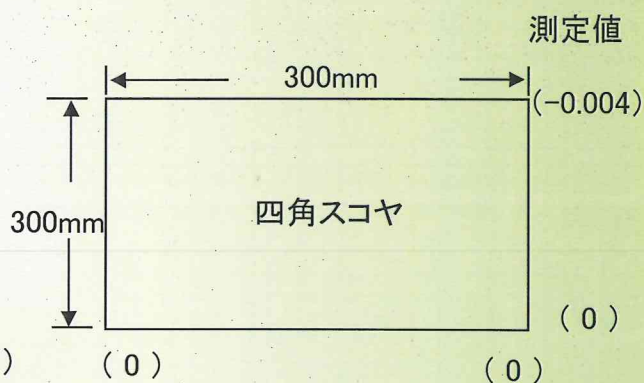

## 上面精度

