

# 精度測定検査表

Examination for precision list


測定日

2014. 3. 26


メーカー	牧野フライス	バーコード	P2053
型式	AHNC74-A4		

精度評価		コメント
A	0 ~ 0.02mm	精度良好です
<b>B</b>	0 ~ 0.03mm	
C	0 ~ 0.04mm	
D	0 ~ 0.05mm	

## 振り回し(300ピッチ)

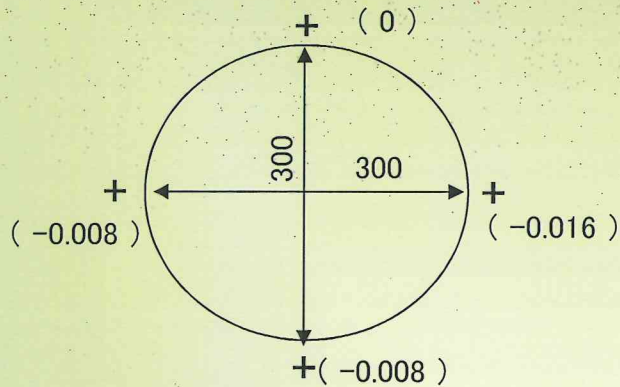


## 主軸振れ

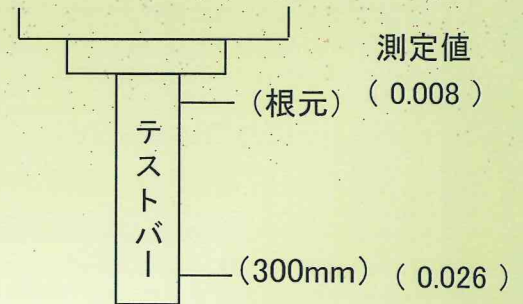


## 直角度


【Y Z】

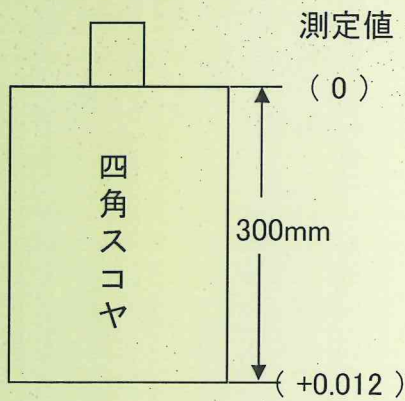

【X Z】

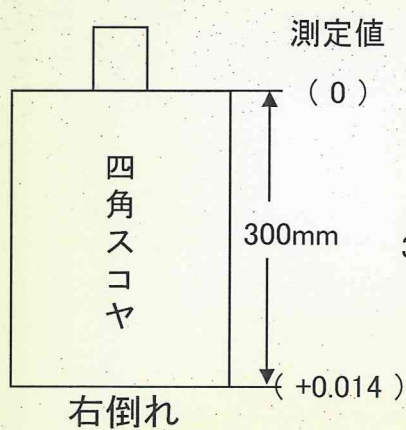

【X Y】

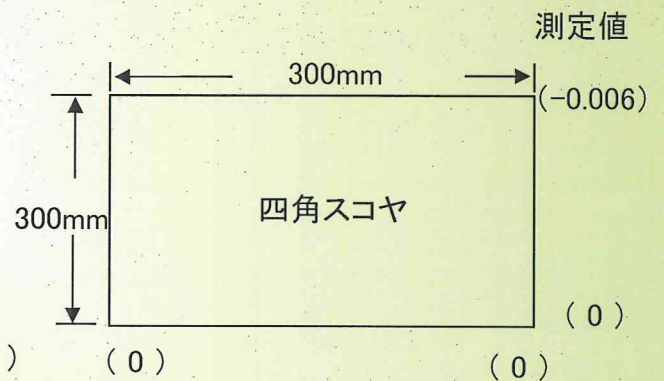

## 上面精度

