

精度測定検査表

Examination for precision list


測定日

2014.5.15


メーカー	ファナック	バーコード	P3060
型式	a-T21iD		

精度評価		コメント
(A)	0 ~ 0.02mm	精度良好
B	0 ~ 0.03mm	
C	0 ~ 0.04mm	
D	0 ~ 0.05mm	

振り回し(300ピッチ)

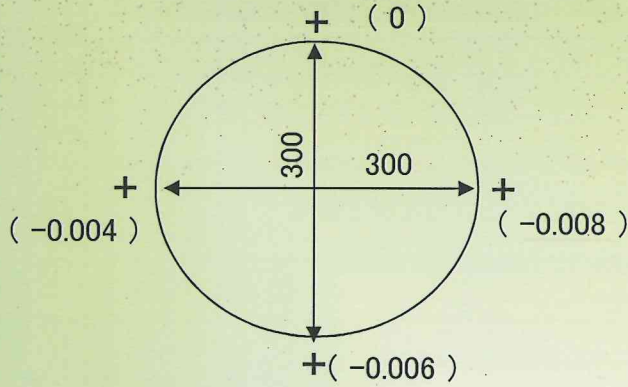


主軸振れ

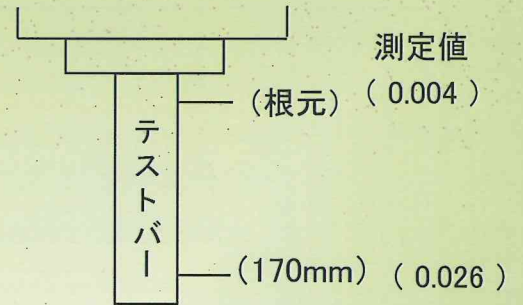


直角度


【Y Z】

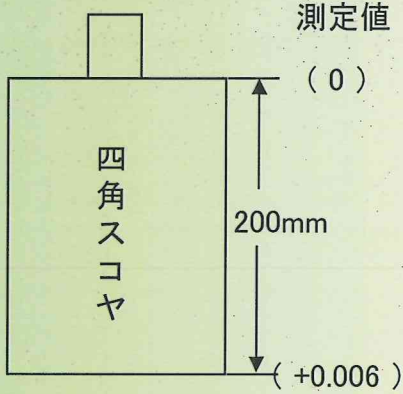

【X Z】

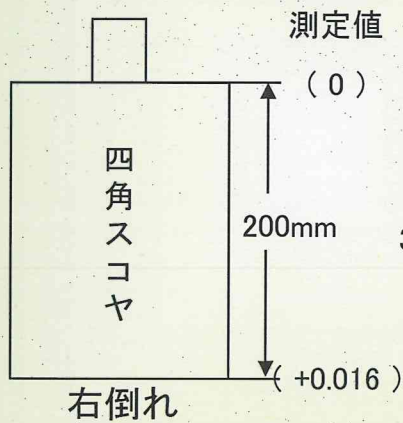

【X Y】

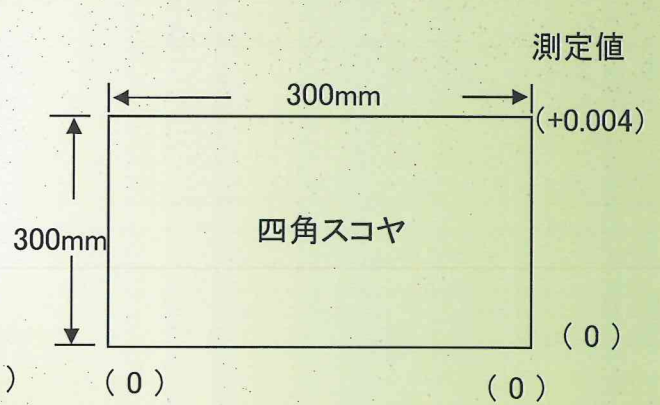

上面精度

