

精度測定検査表


Examination for precision list

測定日 2014. 7. 28


メーカー	ヤマザキマザック	バーコード	P3481
型式	VARIAXIS200		

精度評価		コメント
A	0 ~ 0.02mm	精度良好です。
B	0 ~ 0.03mm	
C	0 ~ 0.04mm	
D	0 ~ 0.05mm	

振り回し(300ピッチ)

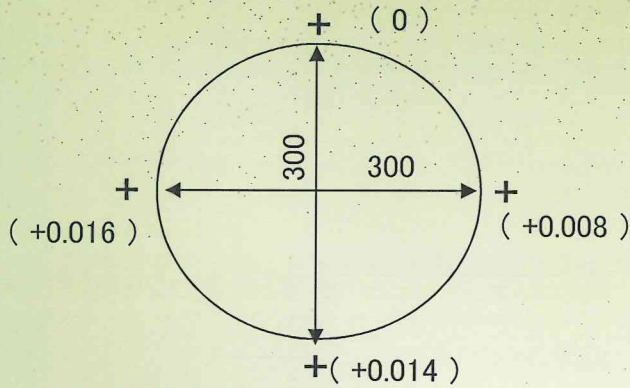


主軸振れ

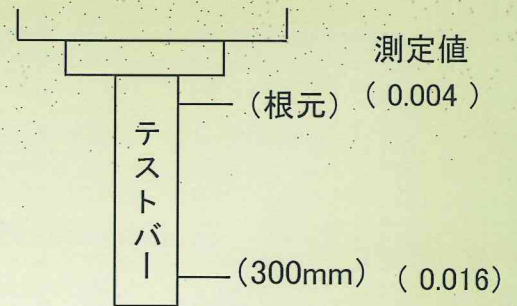


直角度


【Y Z】

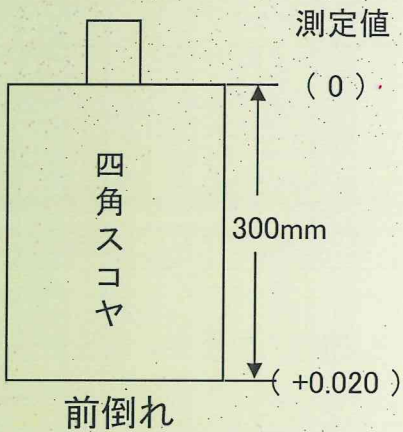

【X Z】

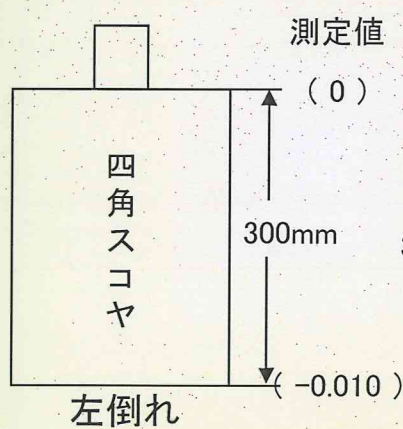

【X Y】

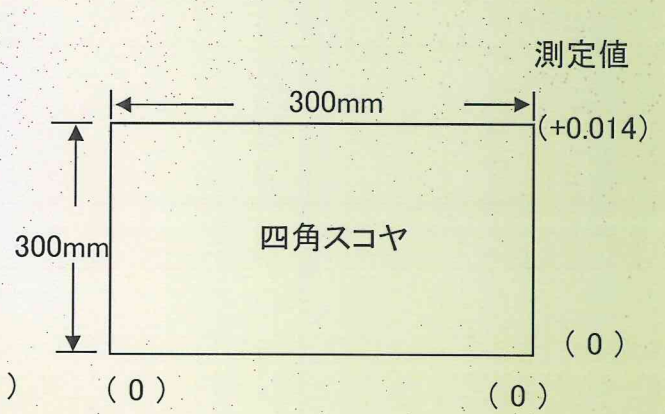

上面精度

