

# 精度測定検査表

Examination for precision list

測定日

2014. 9. 3

精度評価

コメント

A

0 ~ 0.02mm

B

0 ~ 0.03mm

C

0 ~ 0.04mm

D

0 ~ 0.05mm

精度良好です。

メーカー

牧野フライス


バーコード

P2537


型式

V33

## 振り回し(300ピッチ)

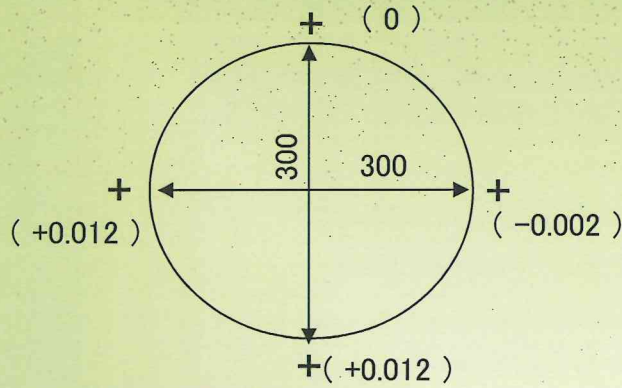


## 主軸振れ

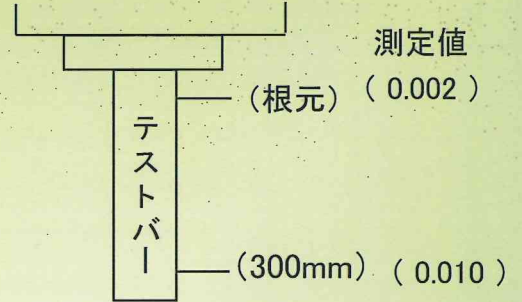


## 直角度


【Y Z】

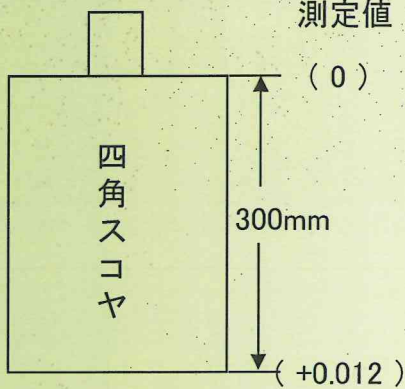

【X Z】

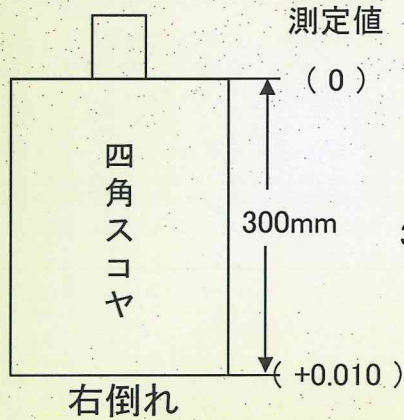

【X Y】

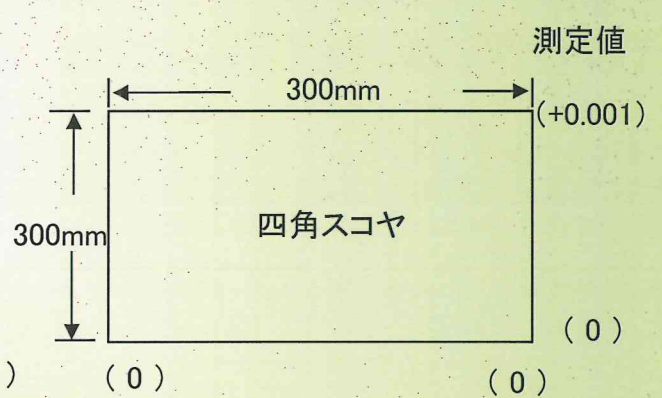

## 上面精度

