


精度測定検査表

Examination for precision list


メーカー	日立精機	バーコード	P2652
型式	HS-400		

精度評価		コメント
A	0 ~ 0.02mm	精度良好です。
B	0 ~ 0.03mm	
C	0 ~ 0.04mm	
D	0 ~ 0.05mm	

Z軸方向の平行度

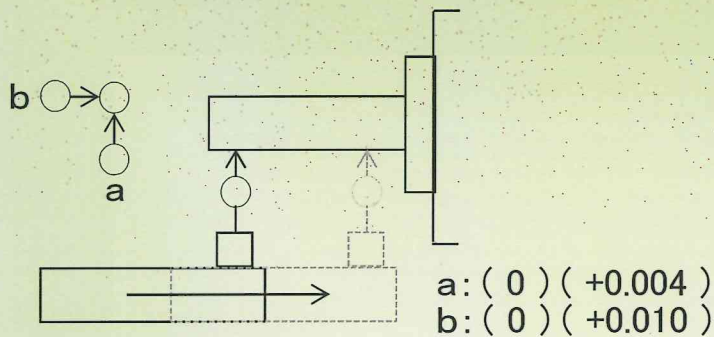


主軸振れ

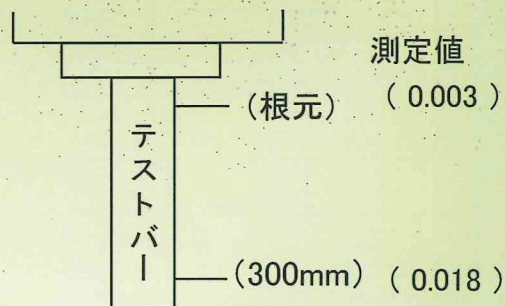


直角度


【Y Z】

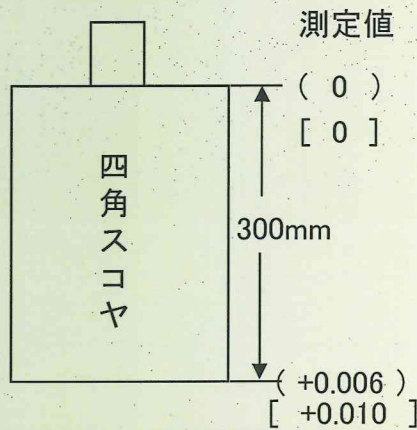

【X Z】

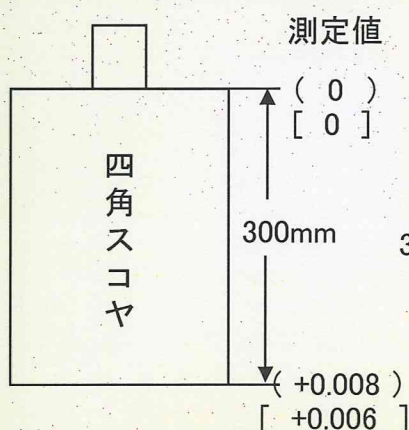

【X Y】

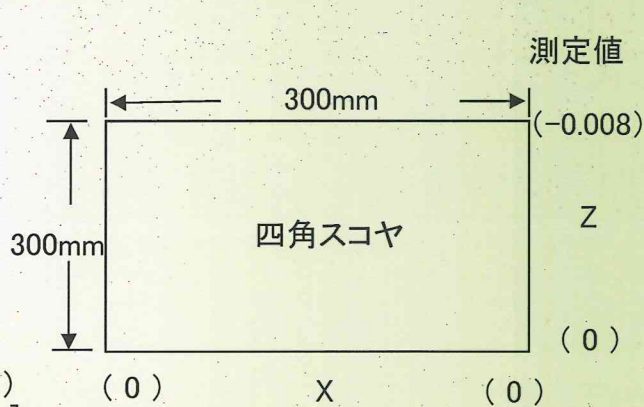

上面精度

(1) [2]

