

精度測定検査表

Examination for precision list



コメント

精度良好です。

メーカー	ファナック	バーコード	P4202
型式	a-T14iCL		


振り回し(300ピッチ)

主軸振れ

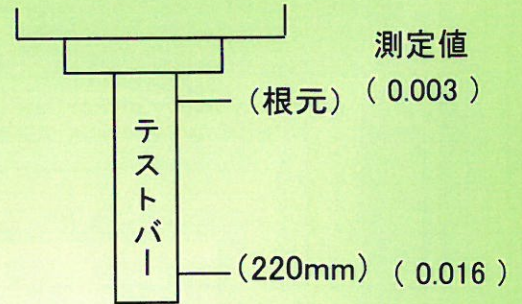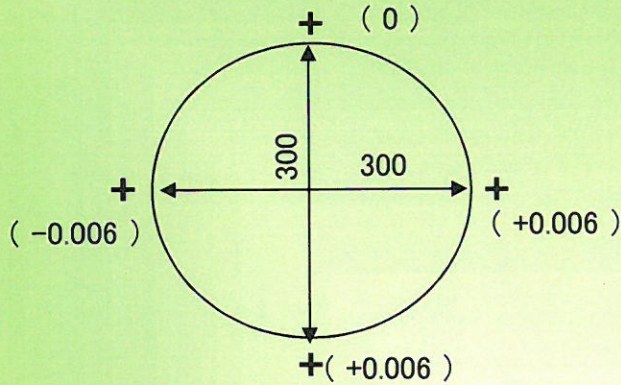


直角度


【Y Z】

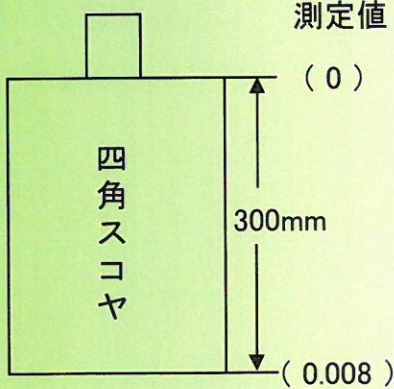

【X Z】

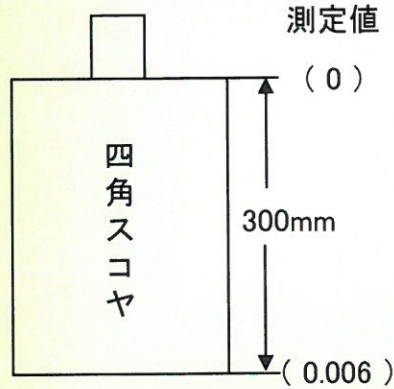

【X Y】

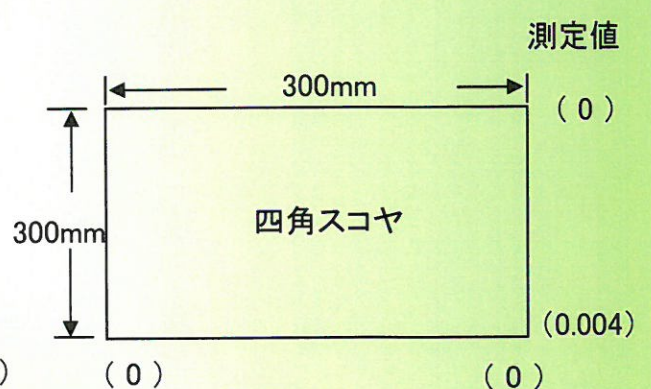

上面精度

