


精度測定検査表

Examination for precision list


精度評価		コメント
A	0 ~ 0.02mm	精度良好です。
B	0 ~ 0.03mm	
C	0 ~ 0.04mm	
D	0 ~ 0.05mm	

メーカー	大隈豊和	バーコード	P4236
型式	MILLAC-1052V		

振り回し(300ピッチ)

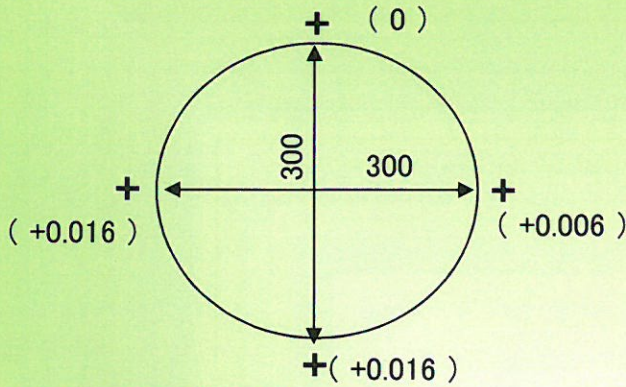


主軸振れ

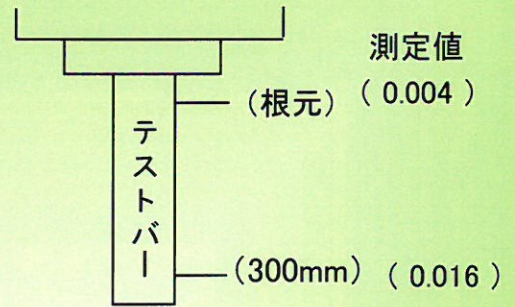


直角度


【Y Z】

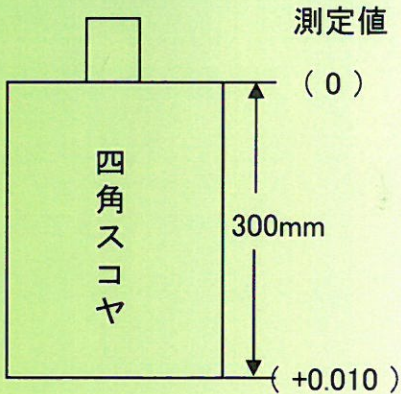

【X Z】

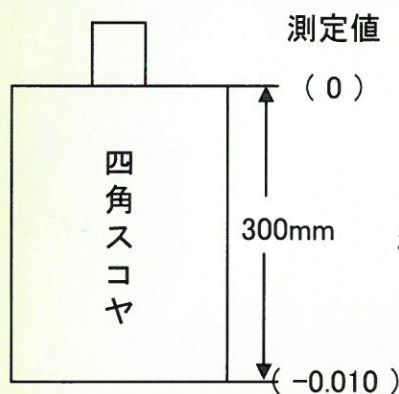

【X Y】

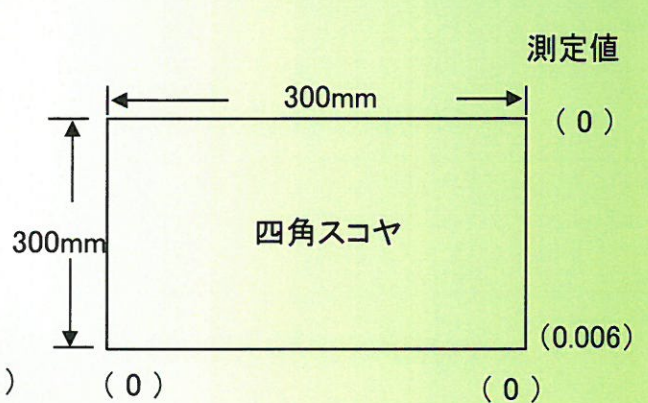

上面精度

上面精度評価	
A	0 ~ 0.04mm
B	0 ~ 0.05mm
C	0 ~ 0.06mm

※テーブル1200以上の時

