


精度測定検査表

Examination for precision list


| | | | |
|------|-----------|-------|-------|
| メーカー | ファナック | バーコード | P4373 |
| 型式 | α-T21iFLa | | |

| 精度評価 | | コメント |
|------|------------|---------|
| A | 0 ~ 0.02mm | 精度良好です。 |
| B | 0 ~ 0.03mm | |
| C | 0 ~ 0.04mm | |
| D | 0 ~ 0.05mm | |

振り回し(300ピッチ)

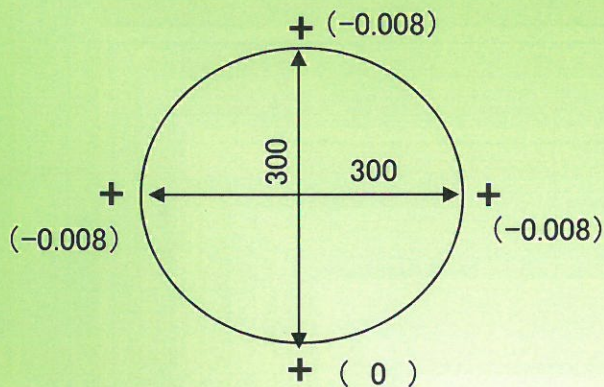

主軸振れ



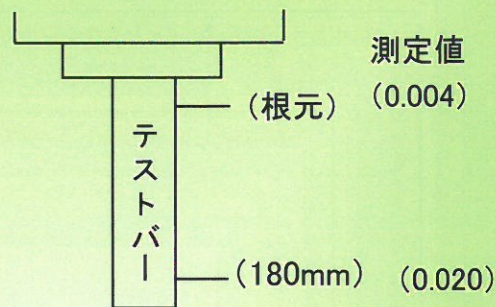


直角度

【YZ】 測定値 (0.020)

【XZ】 測定値 (0.014)

【XY】 測定値 (0.010)

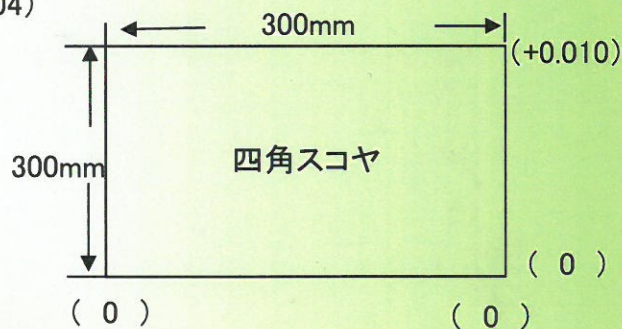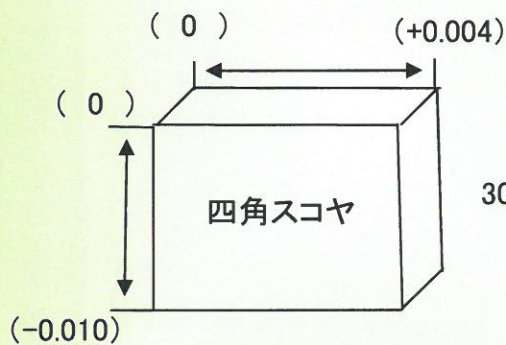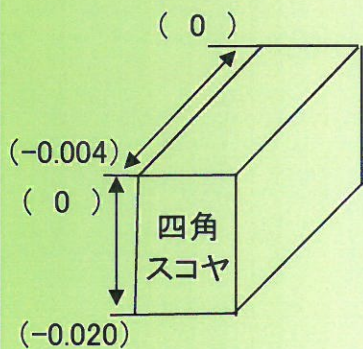

上面精度

