


# 精度測定検査表

Examination for precision list


メーカー	オークマ	バーコード	P4516
型式	MB-56VA		

精度評価		コメント
<b>A</b>	0 ~ 0.02mm	精度良好です。
B	0 ~ 0.03mm	
C	0 ~ 0.04mm	
D	0 ~ 0.05mm	

## 振り回し(300ピッチ)

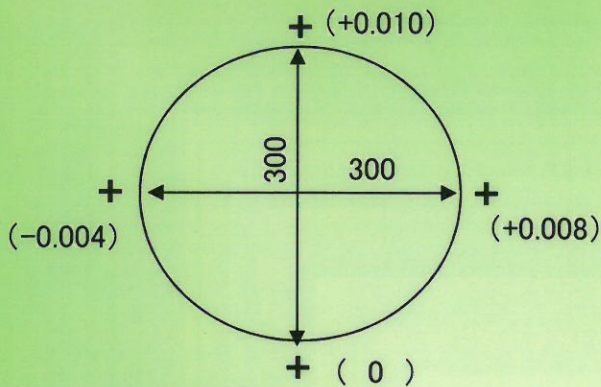

## 主軸振れ



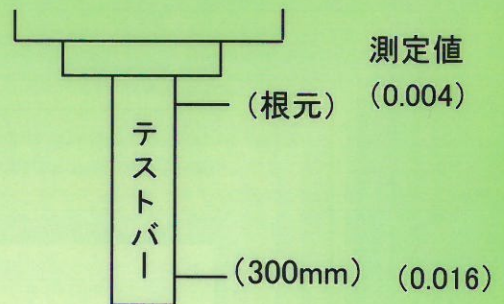


## 直角度

【Y Z】測定値 (0.006)

【X Z】測定値 (0.014)

【X Y】測定値 (0.008)

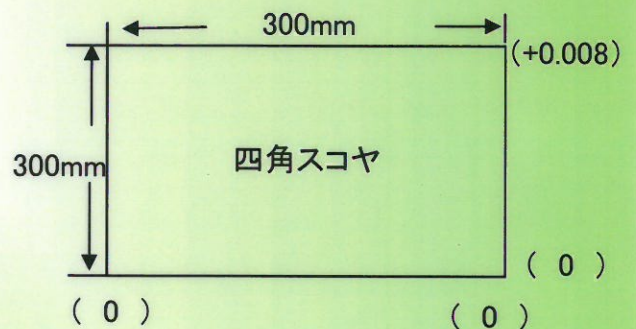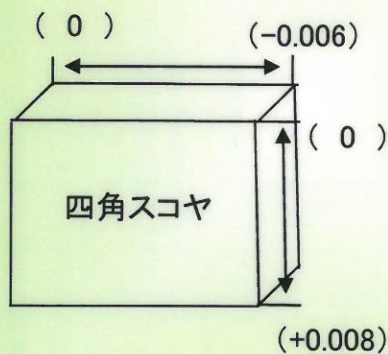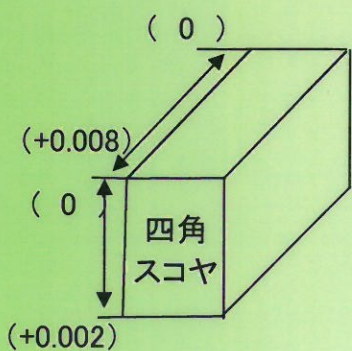

## 上面精度

