



精度測定検査表

Examination for precision list

メーカー	大隈豊和	年式	2004年製	バーコード	P007109
型式	MILLAC-561V	測定者	金子	アシスタント	

振り回し(300ピッチ)

主軸振れ

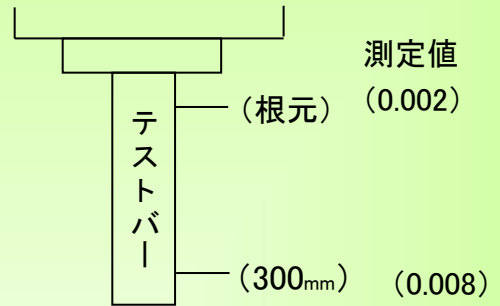
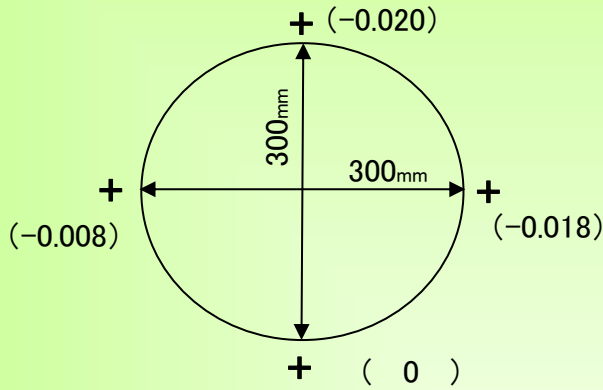


直角度

【YZ】測定値 (0.006)

【XZ】測定値 (0.010)

【XY】測定値 (0.004)

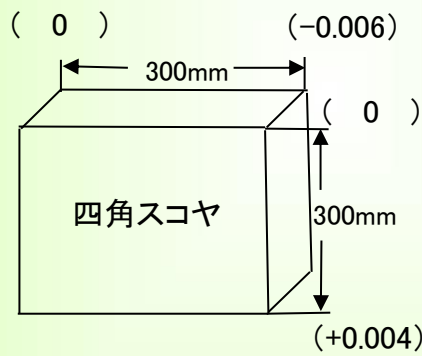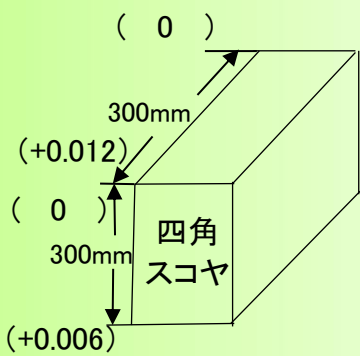

上面精度

※テーブルサイズ 1350×560

