



# 精度測定検査表

*Examination for precision list*

メーカー	森精機	年式	2006年製	バーコード	P006841
型式	NV5000 α 1A/40	測定者	野辺沼	アシスタント	

## 振り回し(300ピッチ)

## 主軸振れ

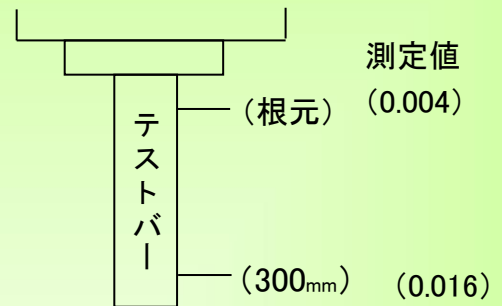
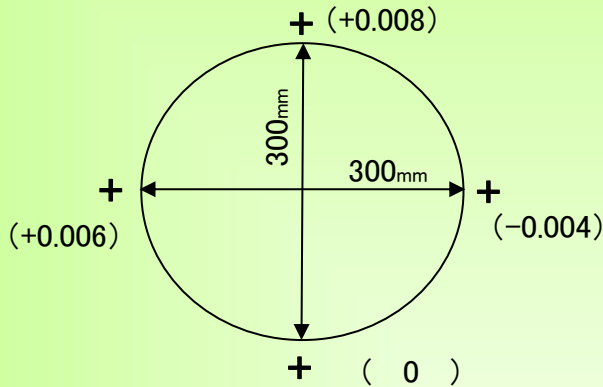


## 直角度

【YZ】測定値 (0.016)

【XZ】測定値 (0.008)

【XY】測定値 (0.014)

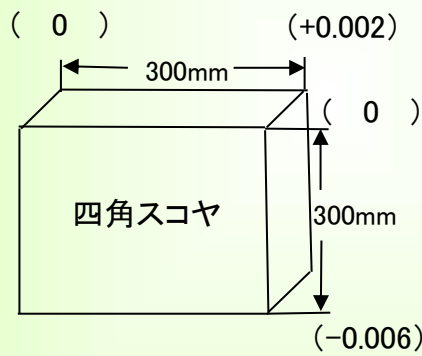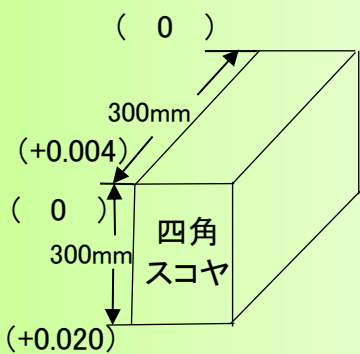

## 上面精度

※テーブルサイズ 1100×600

