



# 精度測定検査表

*Examination for precision list*

メーカー	三井精機	年式	2000年製	バーコード	P006922
型式	VU50A	測定者	武藤	アシスタント	

## 振り回し(300ピッチ)

## 主軸振れ

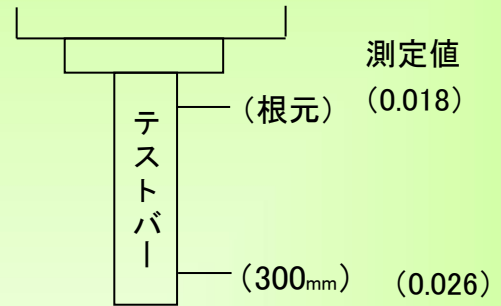
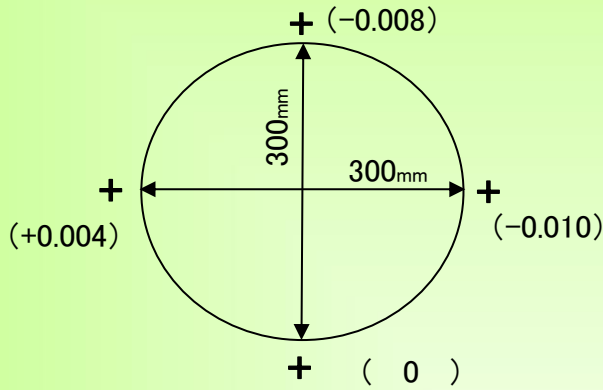


## 直角度

【YZ】測定値 (0.002)

【XZ】測定値 (0.006)

【XY】測定値 (0.010)

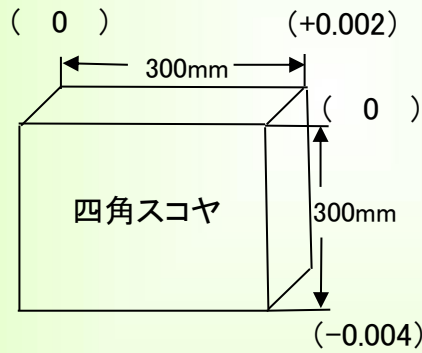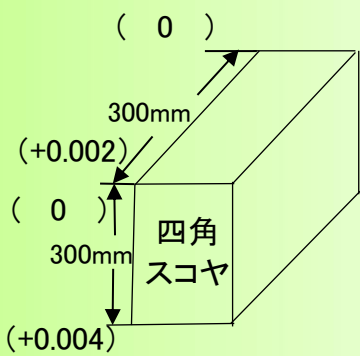

## 上面精度

※テーブルサイズ 1100×580

