


精度測定検査表

Examination for precision list

メーカー	オークマ	管理番号	P006464		
型式	LB300T	年式	2005年製	測定者	宮原


刃物台精度

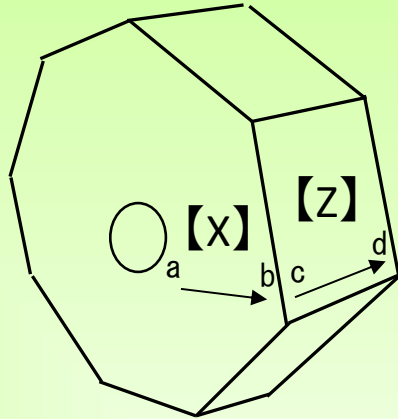

X軸(移動量75mm)
T3(a 0 → b +0.016)
T9(a 0 → b +0.014)

Z軸(移動量70mm)
T3(c 0 → d -0.020)
T9(c 0 → d -0.024)

主軸と刃物台の穴中心精度

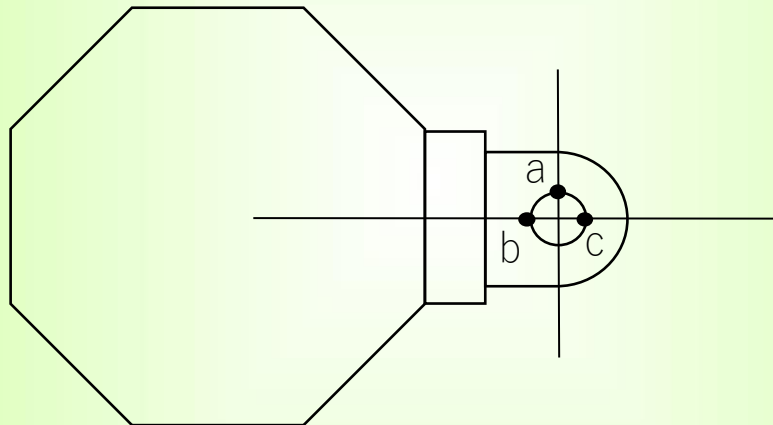

T8
芯ズレ量
a +0.020
b 0
c 0

テスト加工

