



精度測定検査表

Examination for precision list

メーカー	大隈豊和	年式	1995年製	バーコード	P006146
型式	MILLAC-511V	測定者	武藤	アシスタント	

振り回し(300ピッチ)

主軸振れ

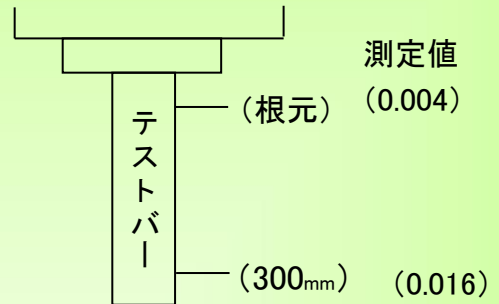
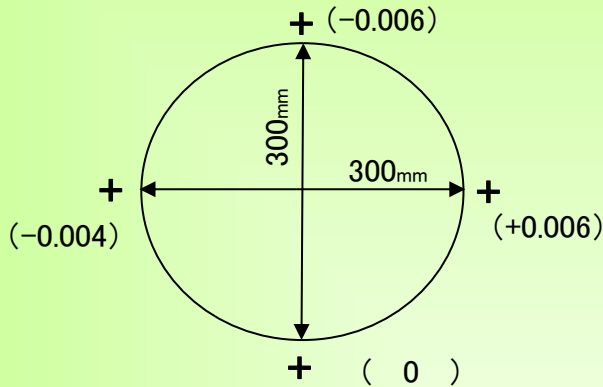


直角度

【YZ】測定値 (0.012)

【XZ】測定値 (0.016)

【XY】測定値 (0.008)

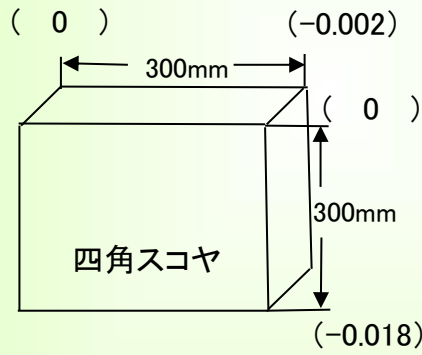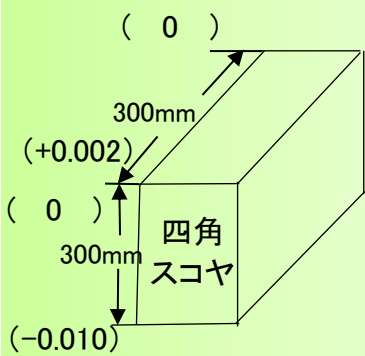

上面精度

※テーブルサイズ 1270×510

