



精度測定検査表

Examination for precision list

| | | | | | |
|------|------------|-----|--------|--------|---------|
| メーカー | 森精機 | 年式 | 2012年製 | 管理番号 | P007173 |
| 型式 | NMV5000DCG | 測定者 | 武藤 | アシスタント | |

振り回し(300ピッチ)

主軸振れ

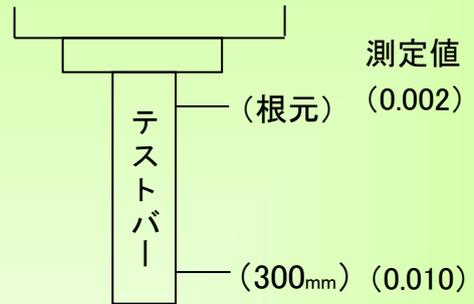
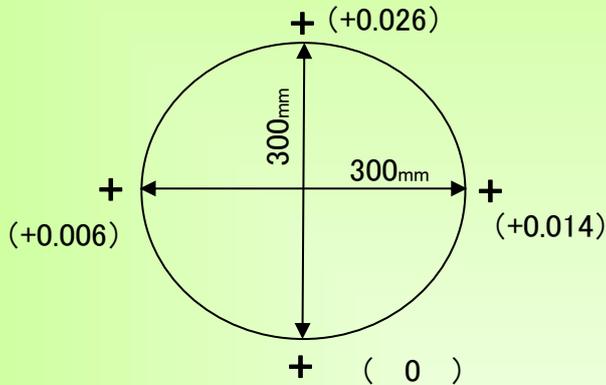


直角度

【YZ】測定値 (0.008)


【XZ】測定値 (0.014)

【XY】測定値 (0.010)

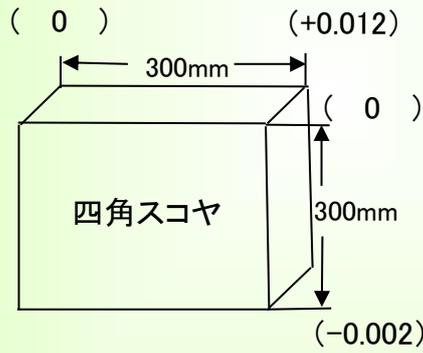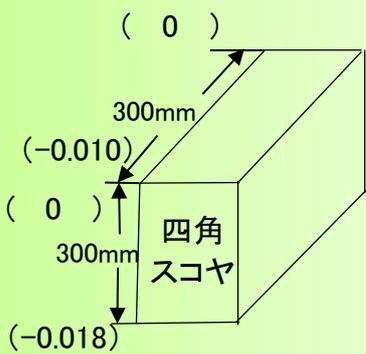

上面精度

※テーブルサイズ Φ500

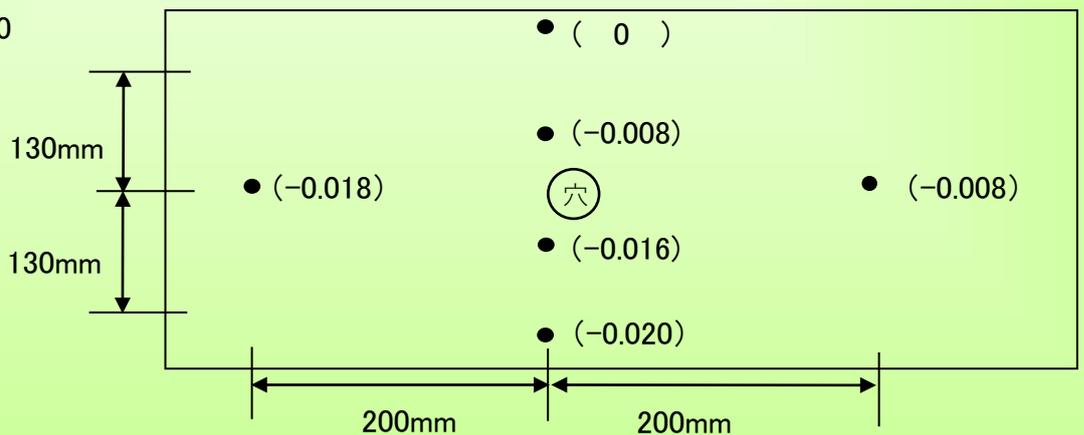

2020/11/12