

# 精度測定検査表

Examination for precision list



メーカー	森精機	年式	2006年製	管理番号	P006768
型式	ACCUMILL4000	測定者	金子	アシスタント	

## 振り回し(300ピッチ)

## 主軸振れ

気温12℃

コラム側


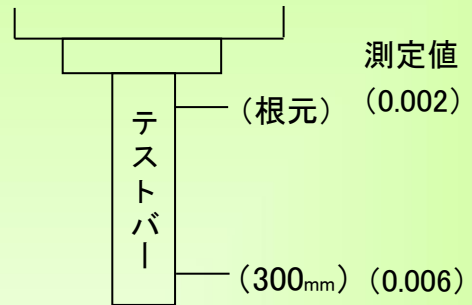
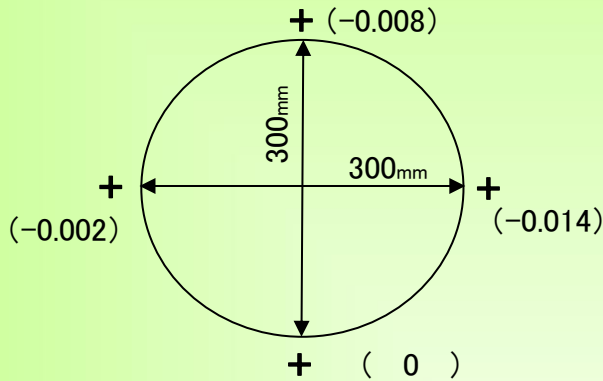


## 直角度

【YZ】測定値 (0.008)

【XZ】測定値 (0.010)


【XY】測定値 (0.016)

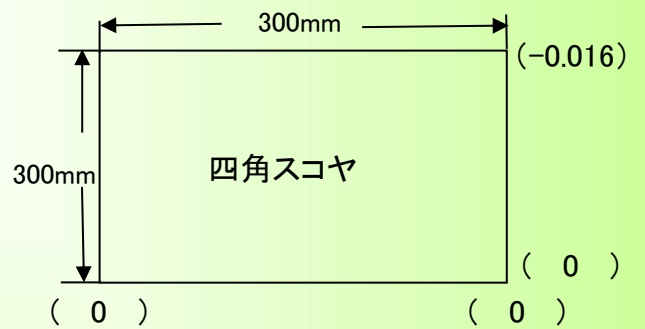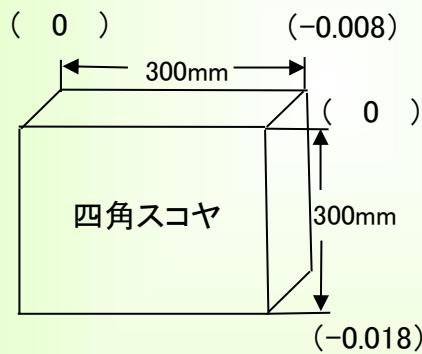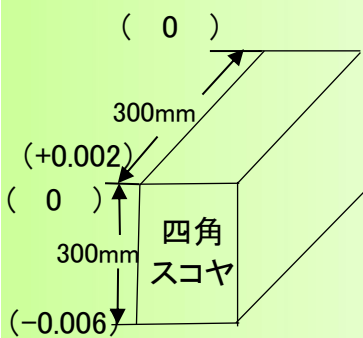

## 上面精度

パレットA... ( )    パレット...B< >

※テーブルサイズ 700×400

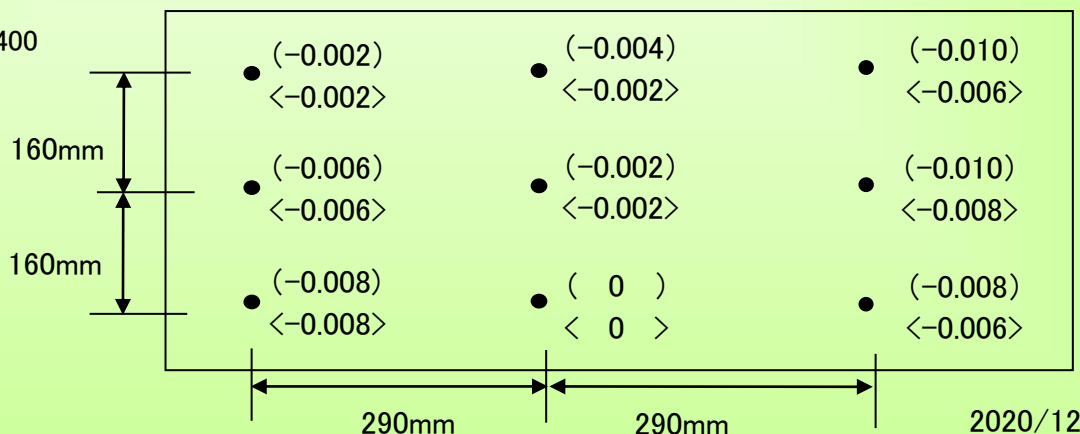

2020/12/8