


精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	森精機	管理番号	P006304
型式	NV5000A/40	年式	2004年製

振り回し(300ピッチ)

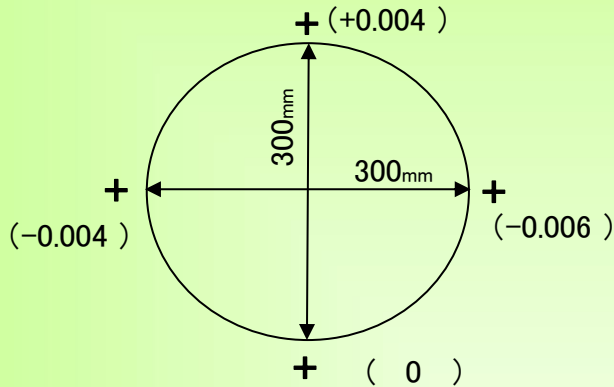

主軸振れ



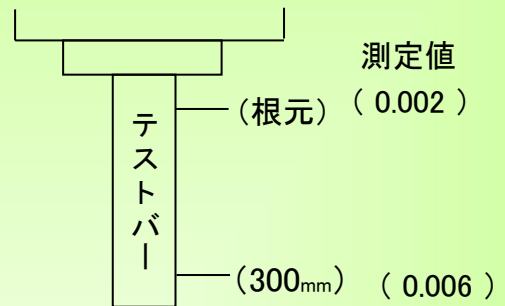


直角度

【Y Z】測定値 (0.010)

【X Z】測定値 (0.014)

【X Y】測定値 (0.004)

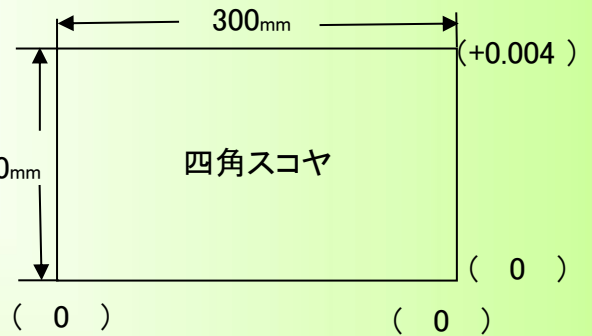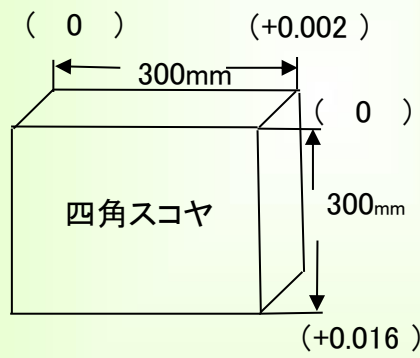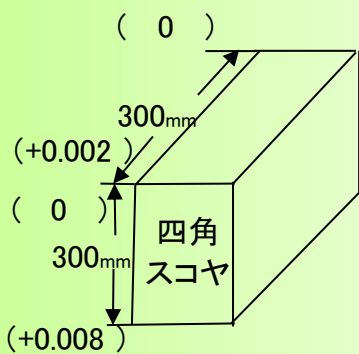

上面精度

