


精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	大隈豊和	管理番号	P006298
型式	MILLAC-415V	年式	1997年製

振り回し(300ピッチ)

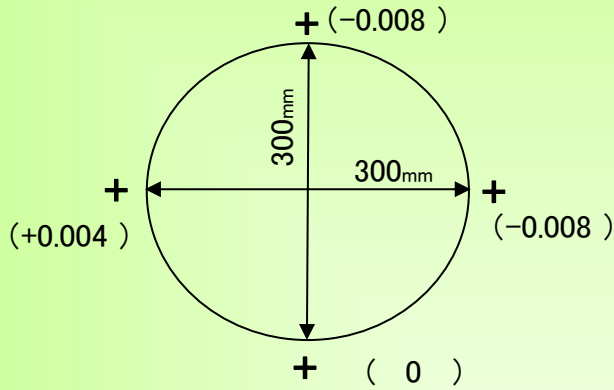

主軸振れ



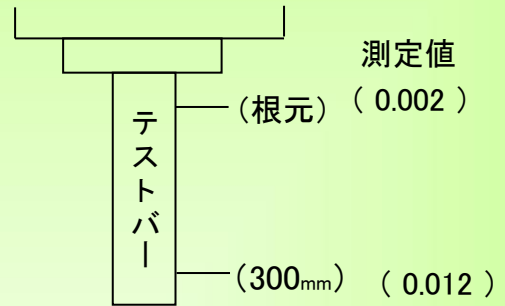


直角度

【Y Z】測定値 (0.002)

【X Z】測定値 (0.006)

【X Y】測定値 (0.006)

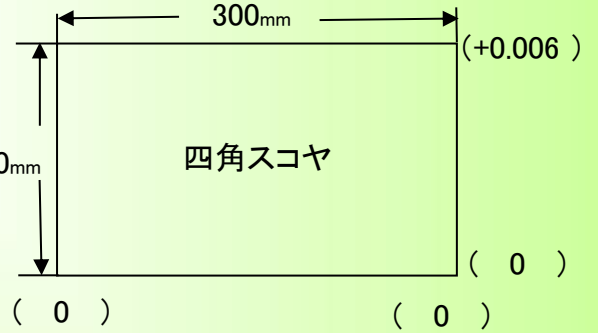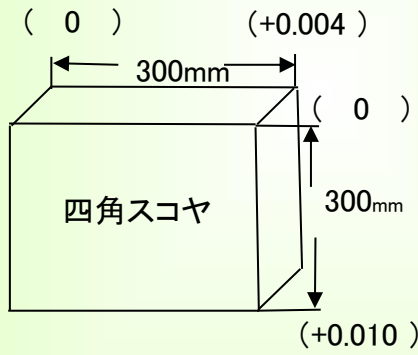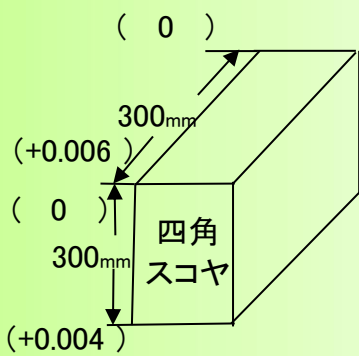

上面精度

