


精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	ファナック	管理番号	P006371
型式	a-T14iA	年式	1998年製

振り回し(300ピッチ)

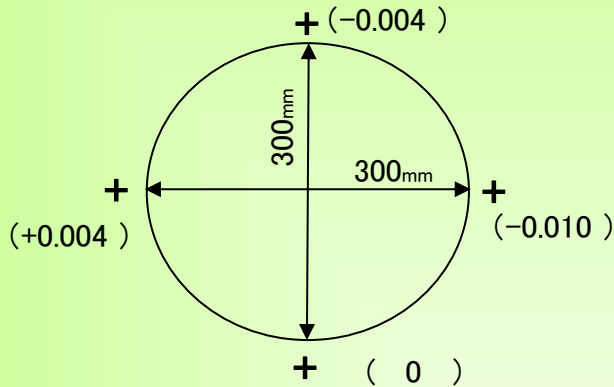

主軸振れ



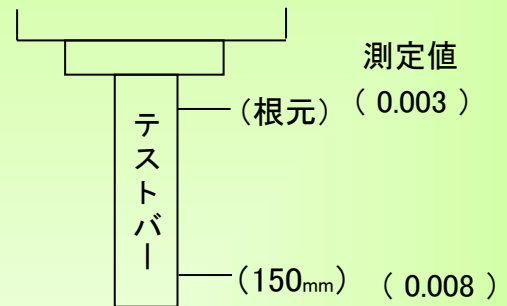


直角度

【Y Z】測定値 (0.018)

【X Z】測定値 (0.010)

【X Y】測定値 (0.010)

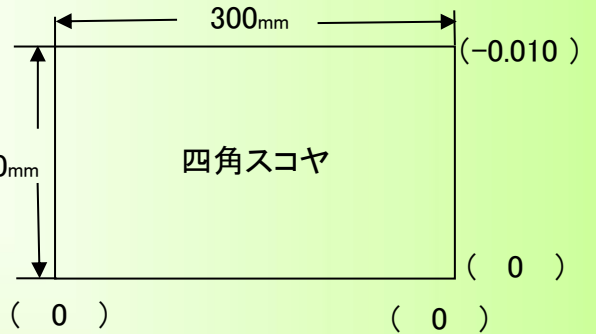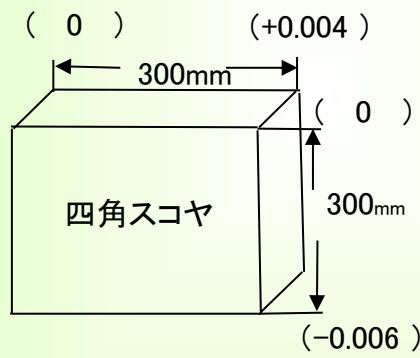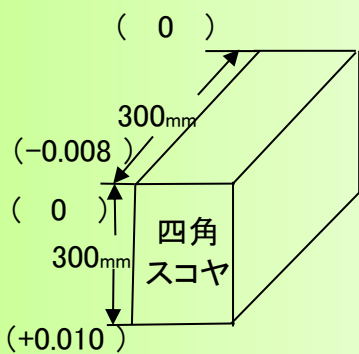

上面精度

