


精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	ファナック	管理番号	P006355
型式	α -T14iCL	年式	2002年製

振り回し(300ピッチ)

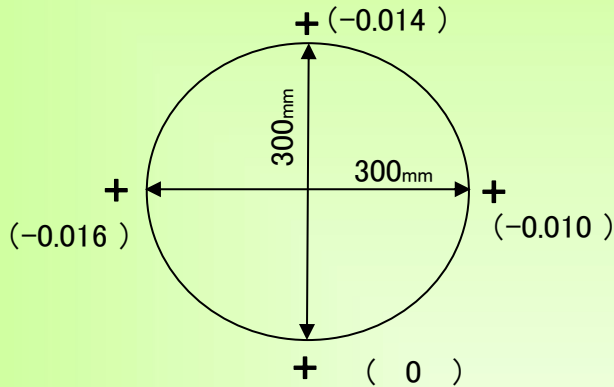

主軸振れ



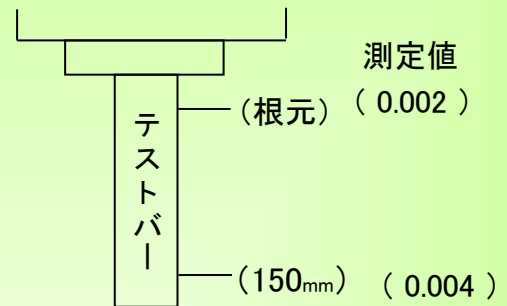


直角度

【Y Z】測定値 (0.016)

【X Z】測定値 (0.006)

【X Y】測定値 (0.006)

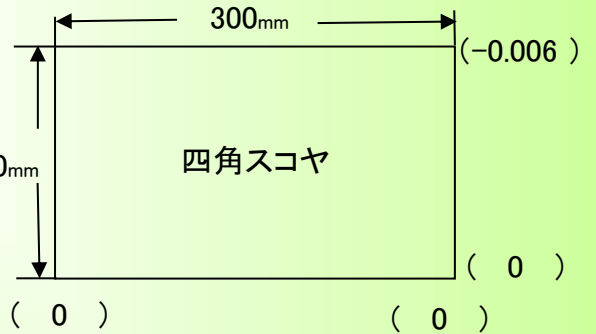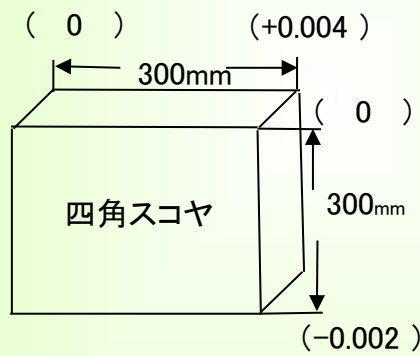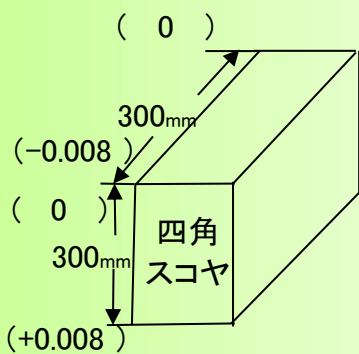

上面精度

