


# 精度測定検査表


*Examination for precision list*

メーカー	森精機	管理番号	P006405
型式	NV4000	年式	2004年製

## 振り回し(300ピッチ)

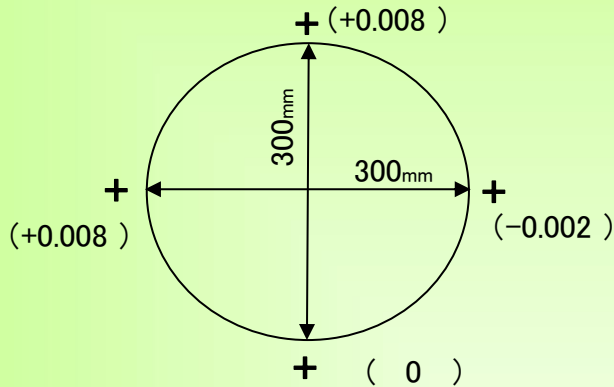

## 主軸振れ



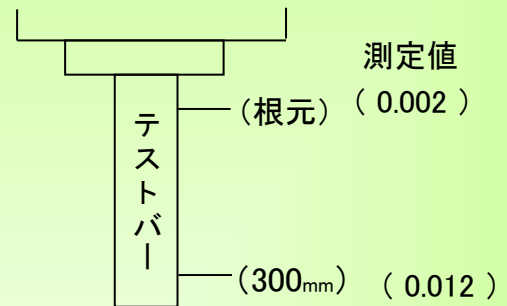


## 直角度

【Y Z】測定値 ( 0.002 )

【X Z】測定値 ( 0.004 )

【X Y】測定値 ( 0.016 )

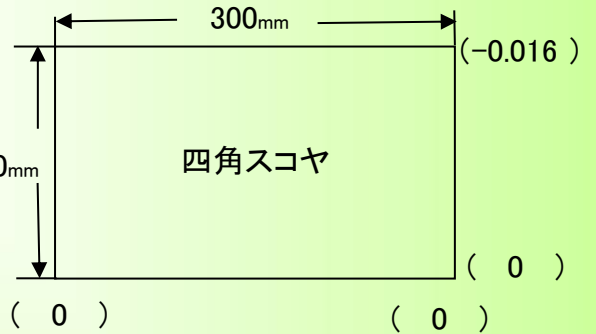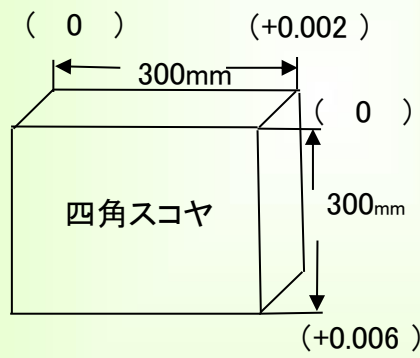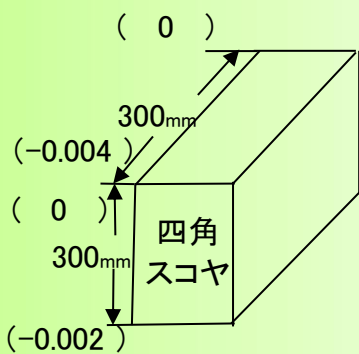

## 上面精度

