


# 精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	森精機	年式	2004年製	バーコード	P006437
型式	NV5000 α 1A/40		測定者	奥澤	アシスタント

## 振り回し(300ピッチ)

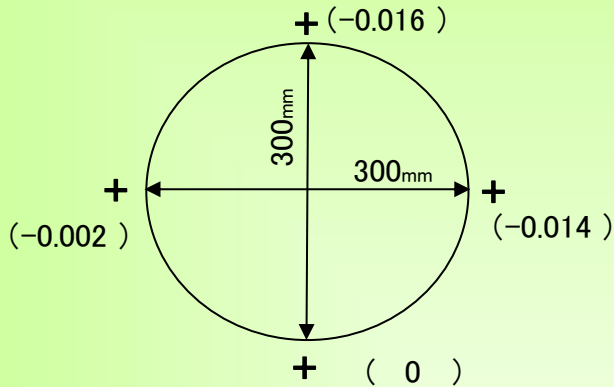

## 主軸振れ



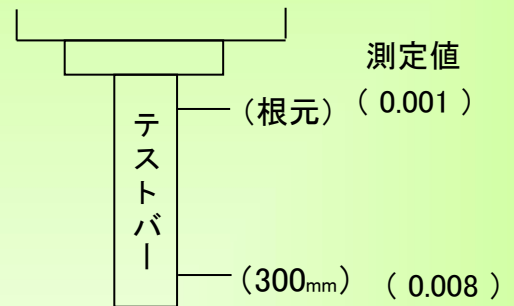


## 直角度

【Y Z】測定値 ( 0.006 )

【X Z】測定値 ( 0.012 )

【X Y】測定値 ( 0.004 )

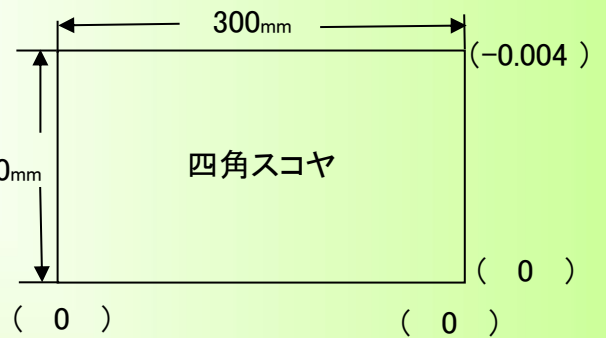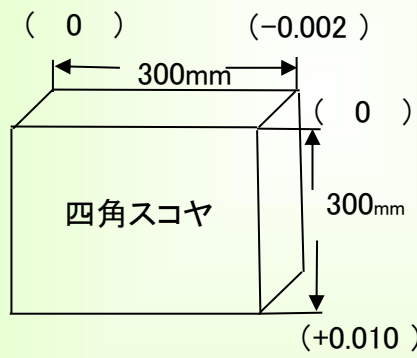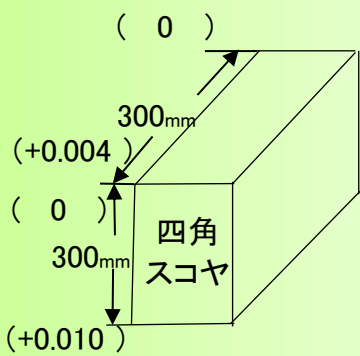

## 上面精度

※テーブルサイズ 1100×600

