


精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	大隈豊和	年式	1998年製	管理番号	H017347
型式	FMB-500	測定者	仙田	アシスタント	

振り回し(300ピッチ)

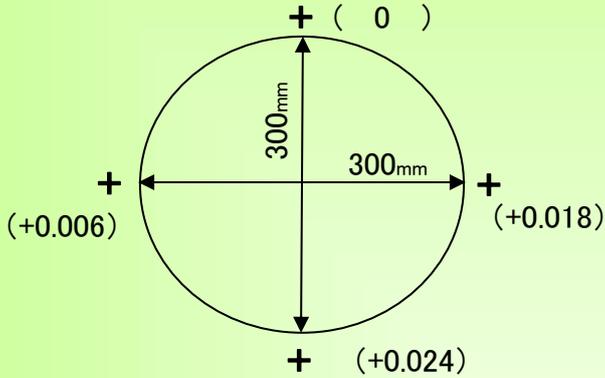

主軸振れ



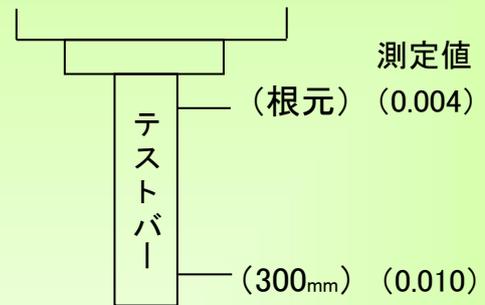


直角度

【YZ】測定値 (0.010)


【XZ】測定値 (0.010)

【XY】測定値 (0.008)

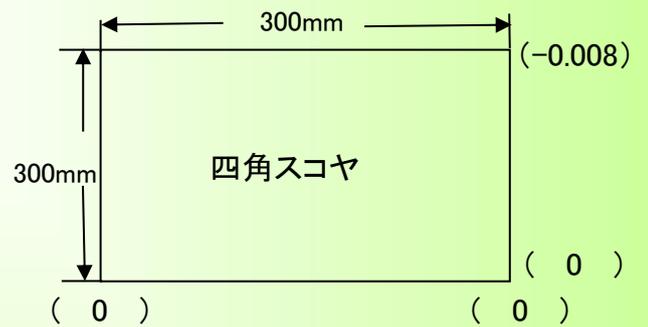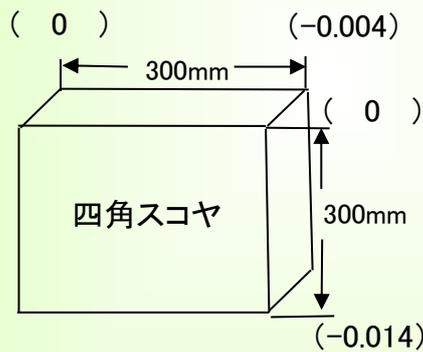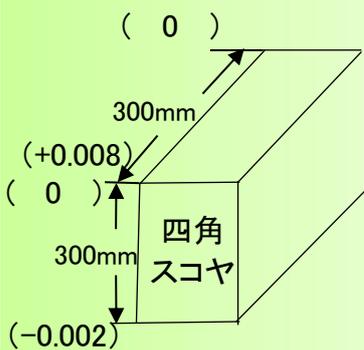

上面精度

※テーブルサイズ 1270×510

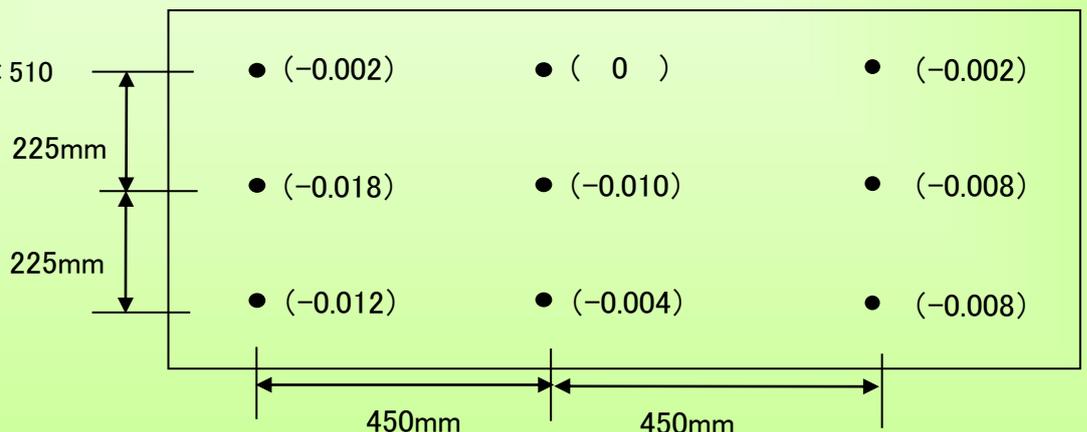

2022/12/15