


精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	森精機	年式	2003年製	バーコード	P006436
型式	NV5000A/40		測定者	金子	アシスタント

振り回し(300ピッチ)

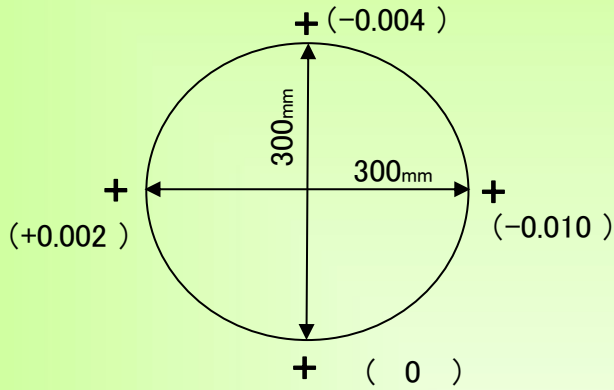

主軸振れ



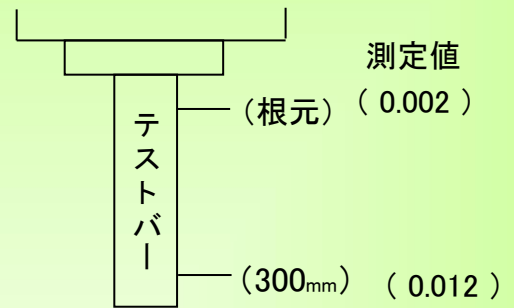


直角度

【Y Z】測定値 (0.004)

【X Z】測定値 (0.006)

【X Y】測定値 (0.004)

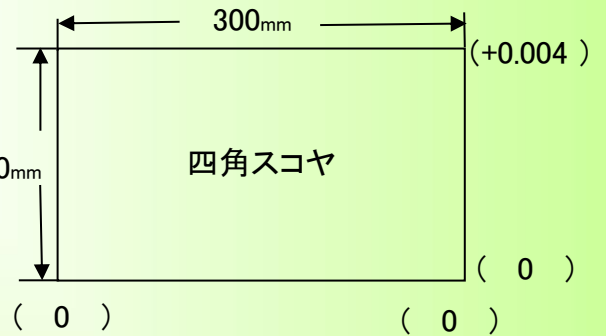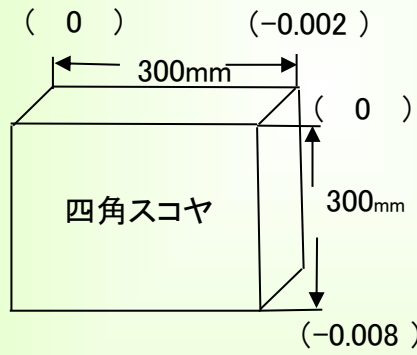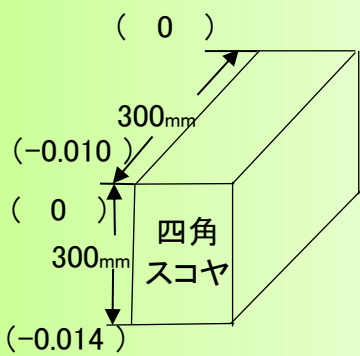

上面精度

※テーブルサイズ 1100×600

