



精度測定検査表

Examination for precision list

メーカー	OKK	年式	2004年製	バーコード	H013765
型式	MCV-860	当社評価	A	測定者	奥澤 アシスタント

振り回し(300ピッチ)

主軸振れ


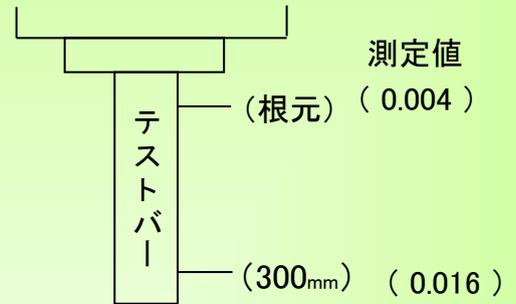
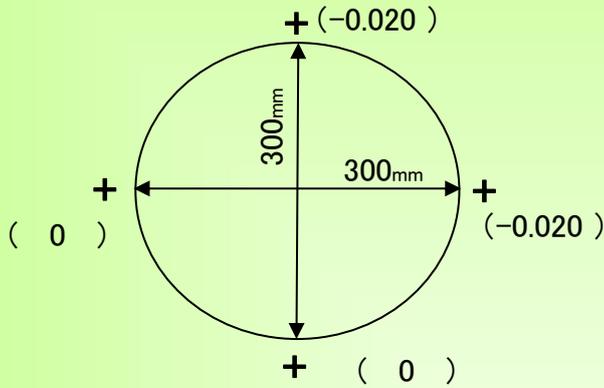


直角度

【Y Z】測定値 (0.010)

【X Z】測定値 (0.018)

【X Y】測定値 (0.010)

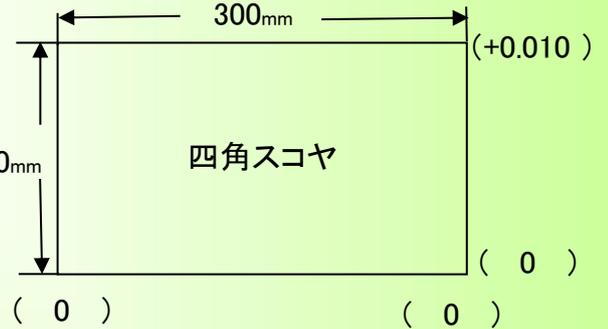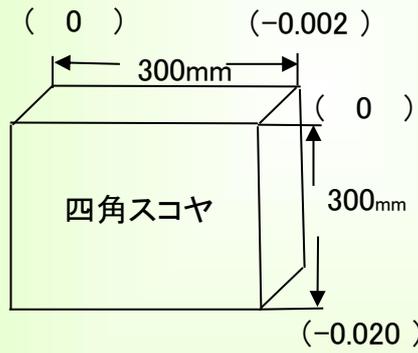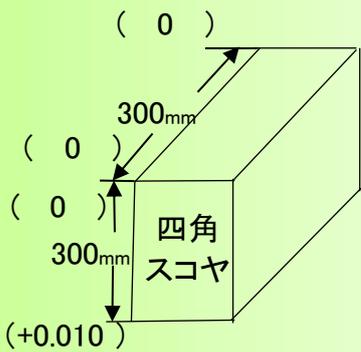

上面精度

※テーブルサイズ 2300×850

