


# 精度測定検査表


*Examination for precision list*

メーカー	森精機	年式	2006年製	管理番号	P008166
型式	NV5000 α 1A/40	測定者	野辺沼	アシスタント	

## 振り回し(300ピッチ)

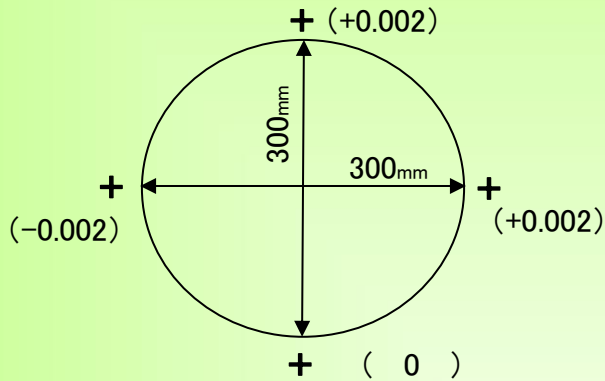

## 主軸振れ



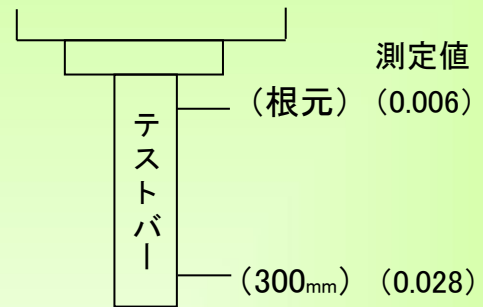


## 直角度

【YZ】 測定値 (0.002)


【XZ】 測定値 (0.010)

【XY】 測定値 (0.004)

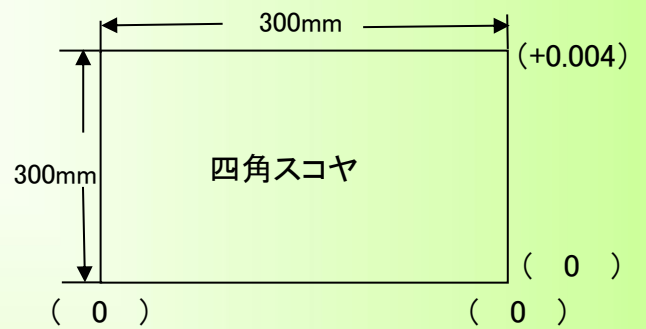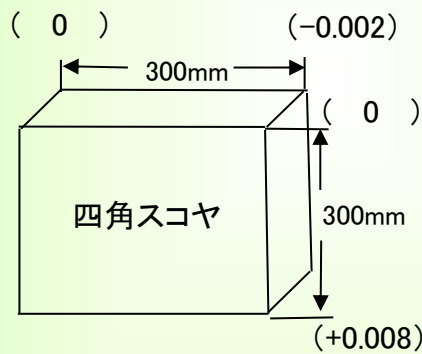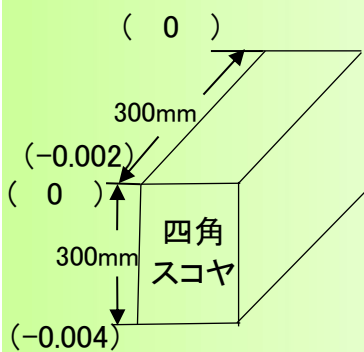

## 上面精度

※テーブルサイズ 1100 × 600

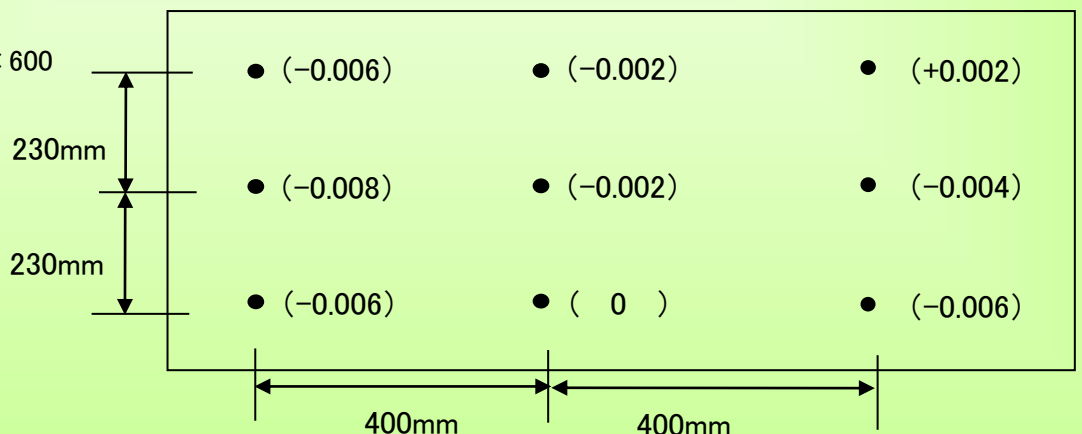

2023/3/2