


精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	大隈豊和	年式	1995年製	バーコード	H013825
型式	FMR-30	当社評価	B+	測定者	仙田 アシスタント

振り回し(300ピッチ)

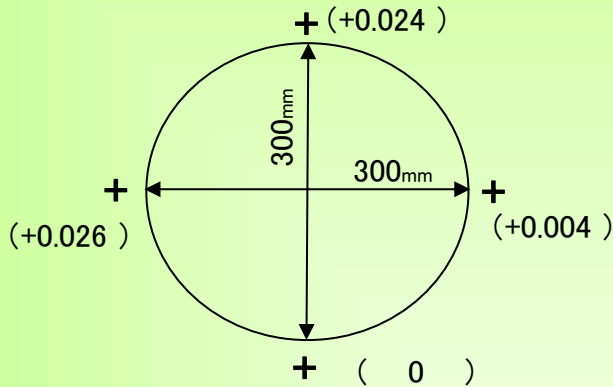

主軸振れ



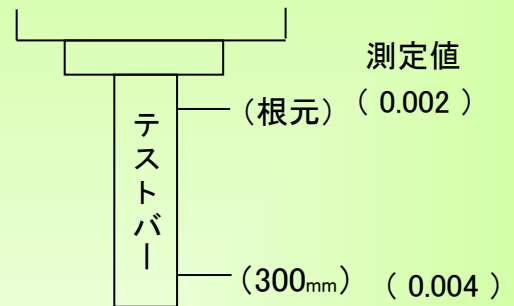


直角度

【Y Z】測定値 (0)

【X Z】測定値 (0.008)

【X Y】測定値 (0.004)

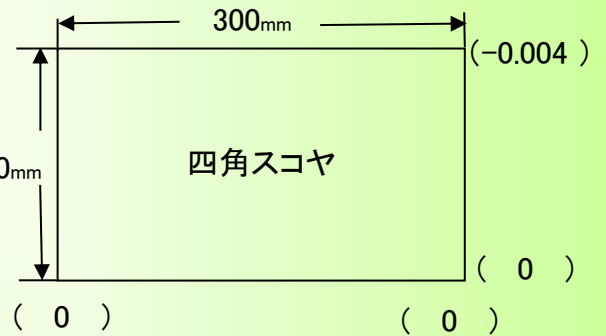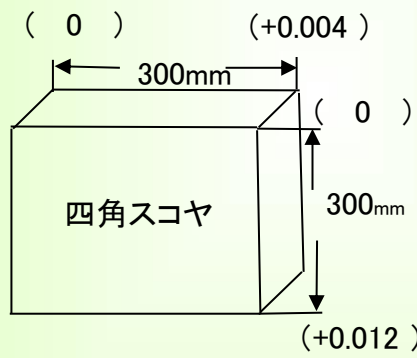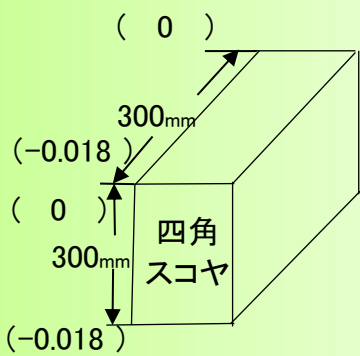

上面精度

※テーブルサイズ 1350×310

