精度測定検査表

Examination for precision list

メーカー	大隈豊和	年式	1995年製	バーコード	H013824
型式	FMR-30	当社評価	B	測定者	仙田	アシスタント	

振り回し(300ピッチ)

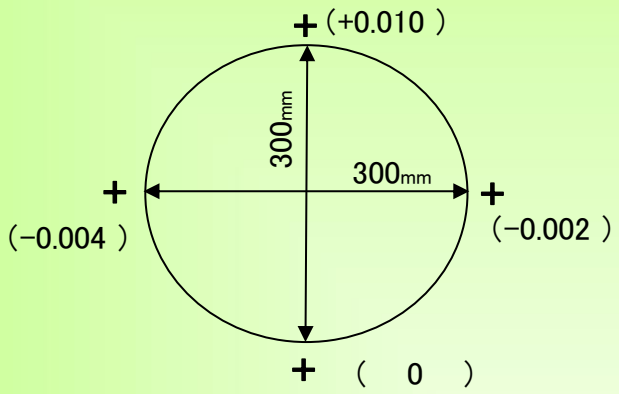

主軸振れ

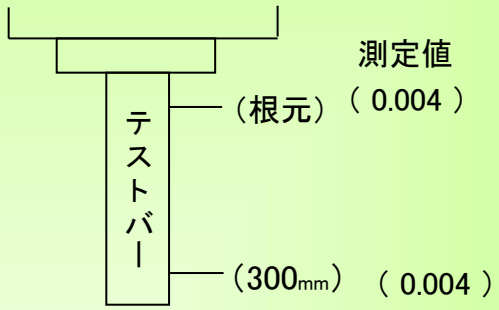

直角度

【Y Z】測定値 (0.010)　【X Z】測定値 (0.023)　【X Y】測定値 (0.002)

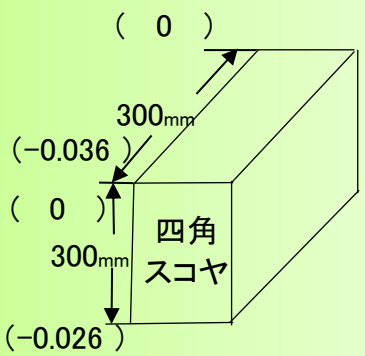

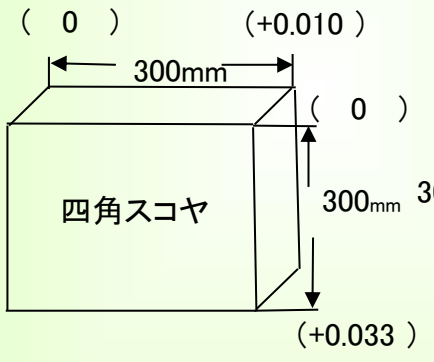

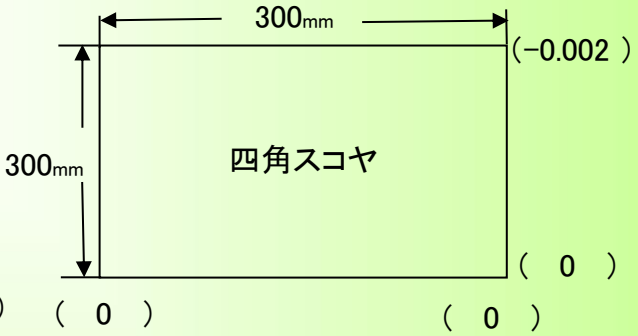

上面精度
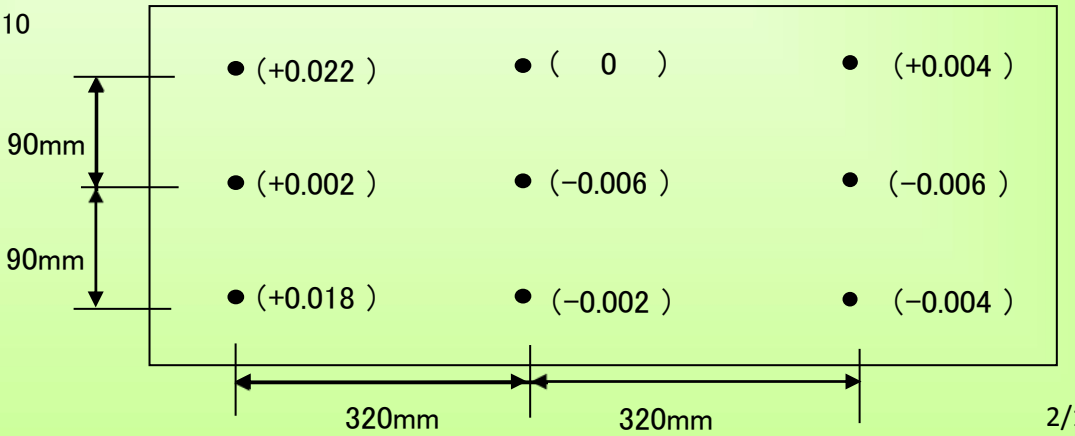
※テーブルサイズ　1350×310