精度測定検査表

Examination for precision list

メーカー	ヤマザキマザック	管理番号	P5986
型式	PFH-5800		

精度評価		コメント
A	0 ～0.02㎜	
B	0 ～0.03㎜	
C	0 ～0.04㎜	
D	0 ～0.05㎜	

Z軸方向の平行度

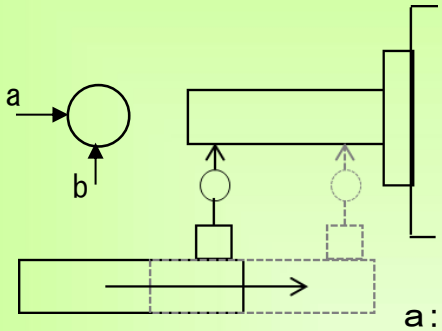

a:(　0　)(+0.018)
b:(　0　)(−0.004)

主軸振れ

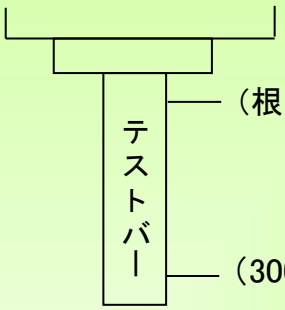

測定値
（根元）(0.002)
(300㎜) (0.012)

直角度

【XY】測定値 (0.006)　【ZY】測定値 (0.016)　【ZX】測定値(0.012)

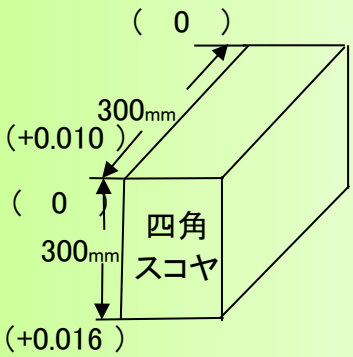

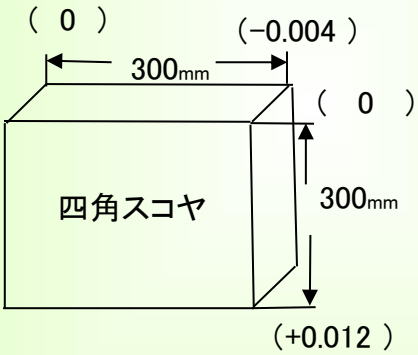

上面精度

テーブルサイズ:500角
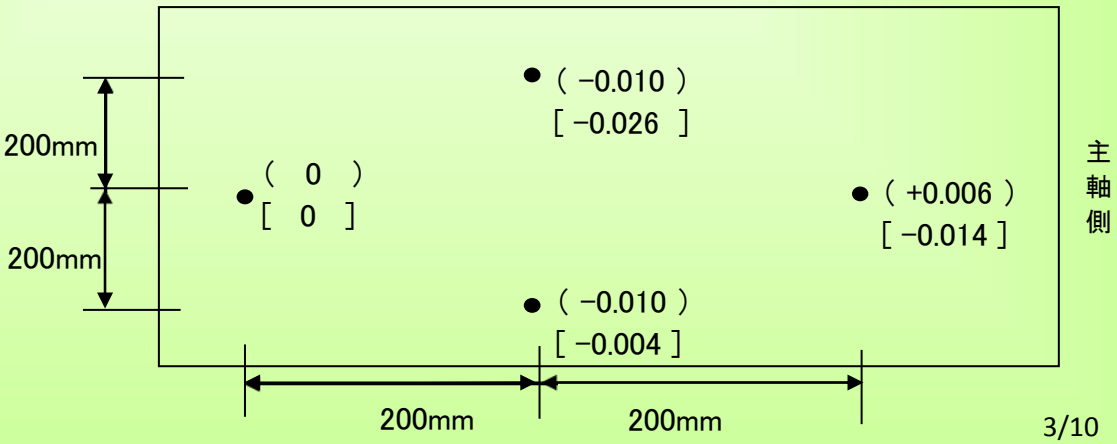
(　　)→パレット3
[　　]→パレット2