


精度測定検査表


Examination for precision list

| | | | | | |
|------|------------|-----|-------|--------|---------|
| メーカー | 大隈豊和 | 年式 | 2005年 | 管理番号 | P008219 |
| 型式 | MILLAC-44V | 測定者 | 金子 | アシスタント | |

振り回し(300ピッチ)

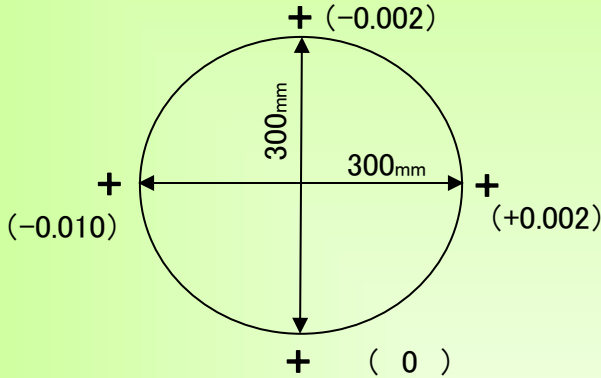

主軸振れ



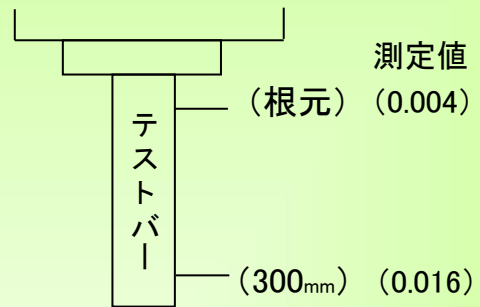


直角度

【YZ】測定値 (0.006)

【XZ】測定値 (0.010)


【XY】測定値 (0.002)

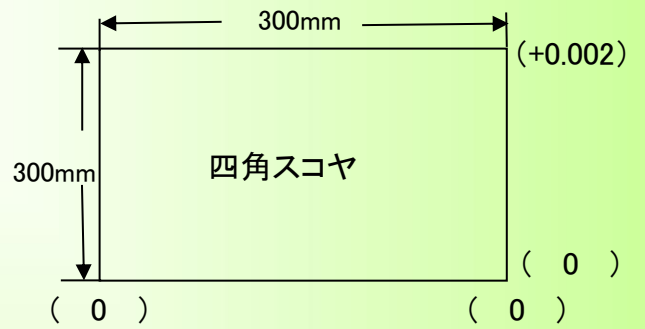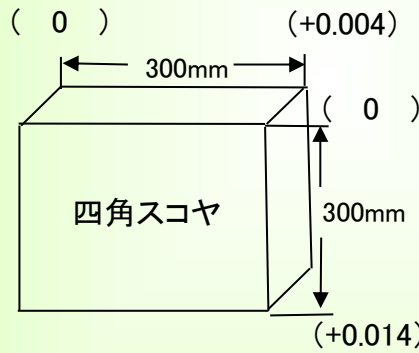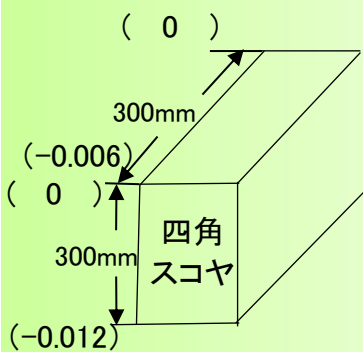

(バックラッシュ X: 0.002 Y: 0.002 Z: 0.002)

上面精度

※テーブルサイズ 630×400

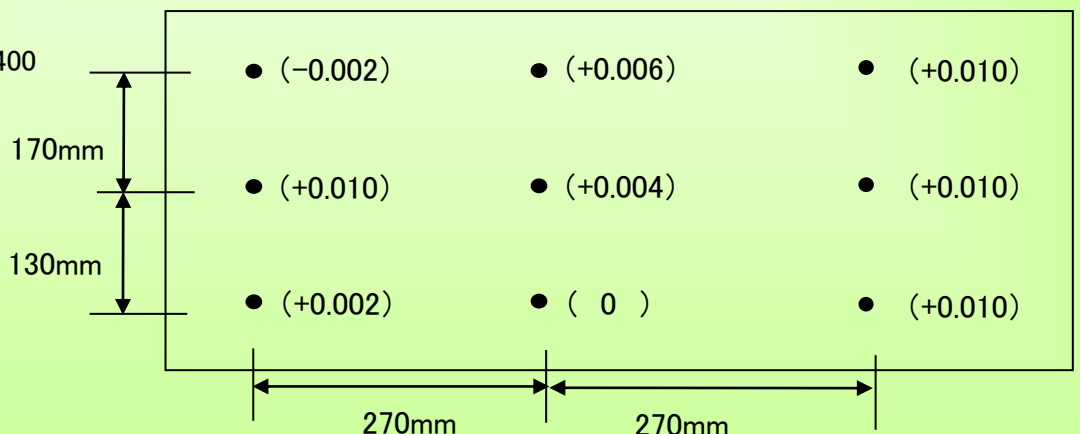

2023/5/23