精度測定検査表

Examination for precision list

メーカー	森精機	年式	2008年製		バーコード	P006528	
型式	NV5000α1A/40	当社評価	A	測定者	金子	アシスタント	

振り回し(300ピッチ)

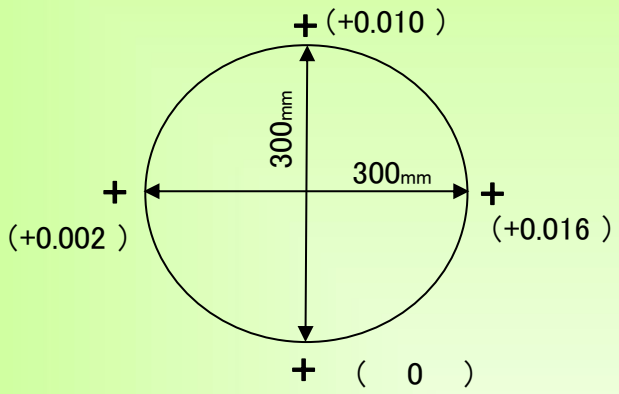

主軸振れ

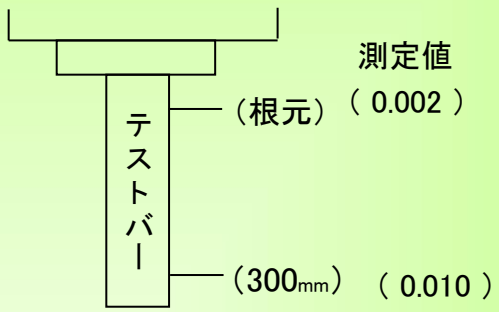

直角度

【Y Z】測定値 (0.010)　【X Z】測定値 (0.016)　【X Y】測定値 (0.004)

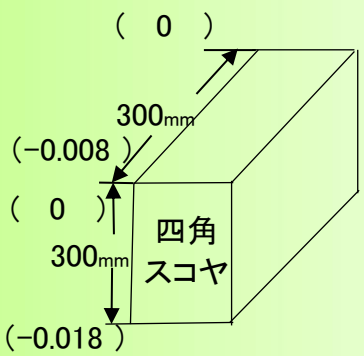

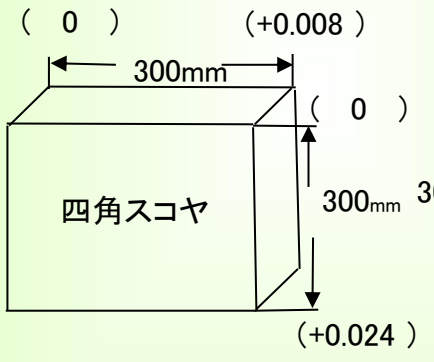

上面精度
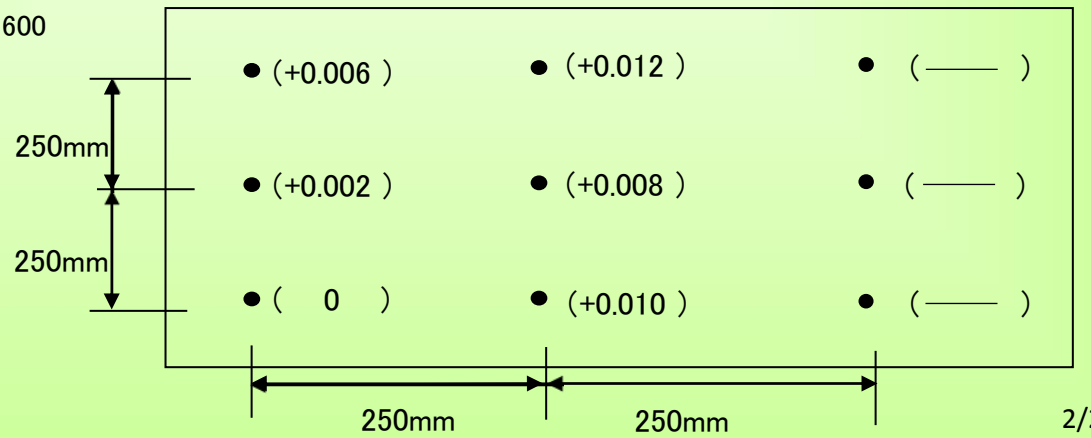
※テーブルサイズ　1100×600