


精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	大隈豊和	年式	2006年	管理番号	P008252
型式	MILLAC-44V	測定者	金子	アシスタント	

振り回し(300ピッチ)

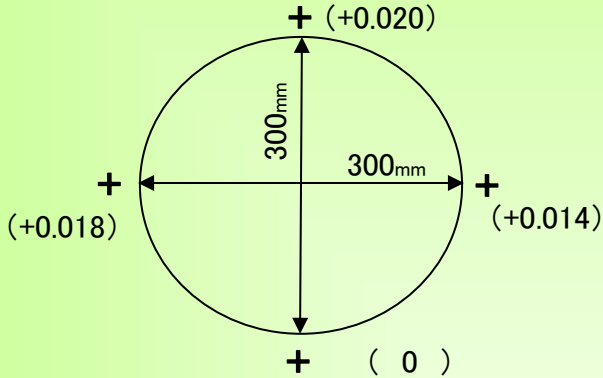

主軸振れ



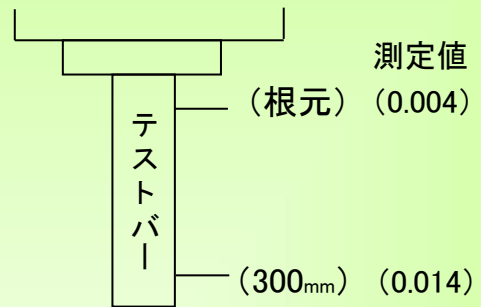


直角度

【YZ】測定値 (0.020)


【XZ】測定値 (0.014)

【XY】測定値 (0.004)

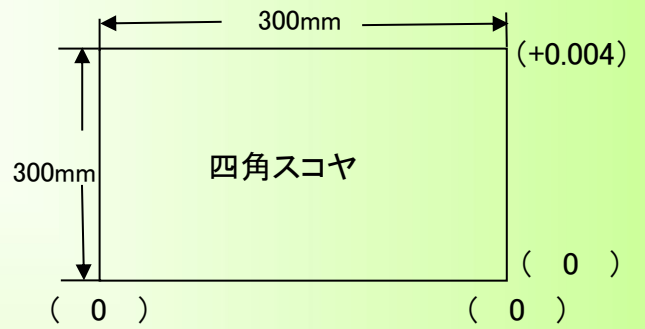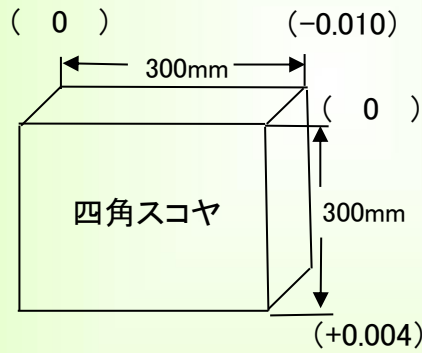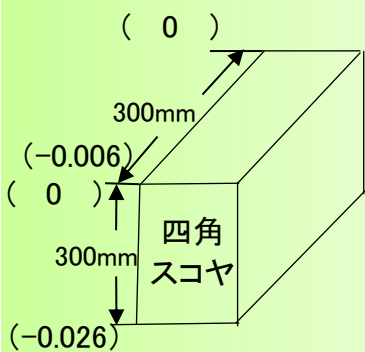

上面精度

※テーブルサイズ 630×400

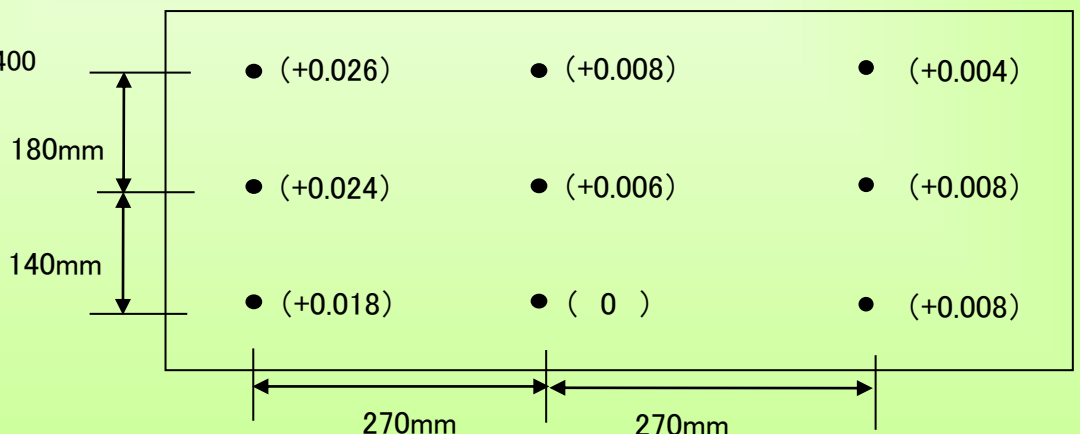

2023/7/7