


精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	OKK	年式	2005	管理番号	P008034
型式	VP600-5AX	測定者	武藤	アシスタント	

振り回し(300ピッチ)

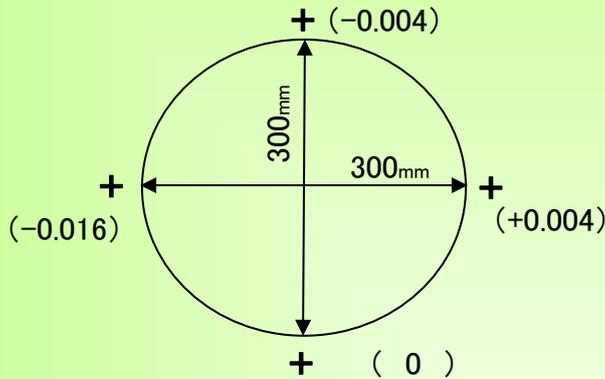

主軸振れ



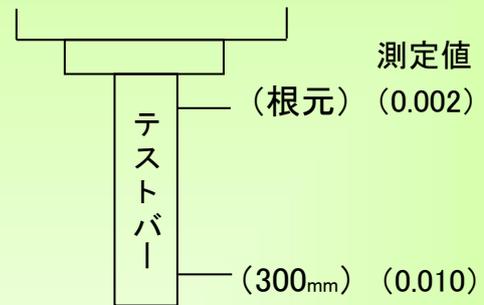


直角度

【YZ】測定値 (0.008)


【XZ】測定値 (0.018)

【XY】測定値 (0.018)

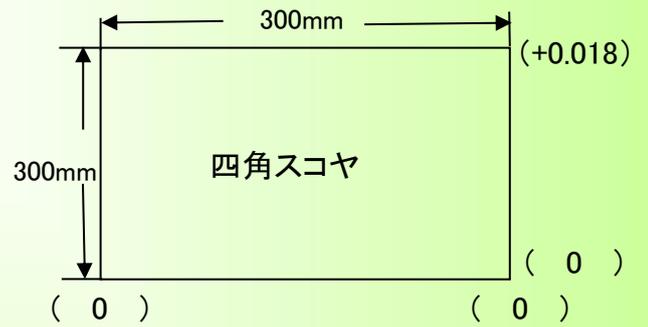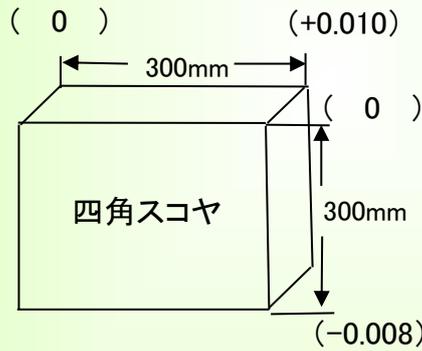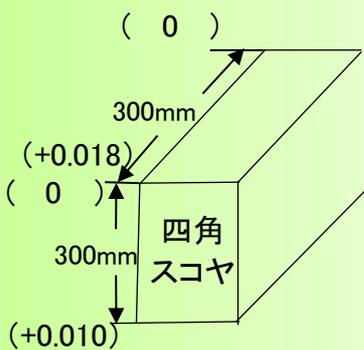

上面精度

※テーブルサイズ 500×500

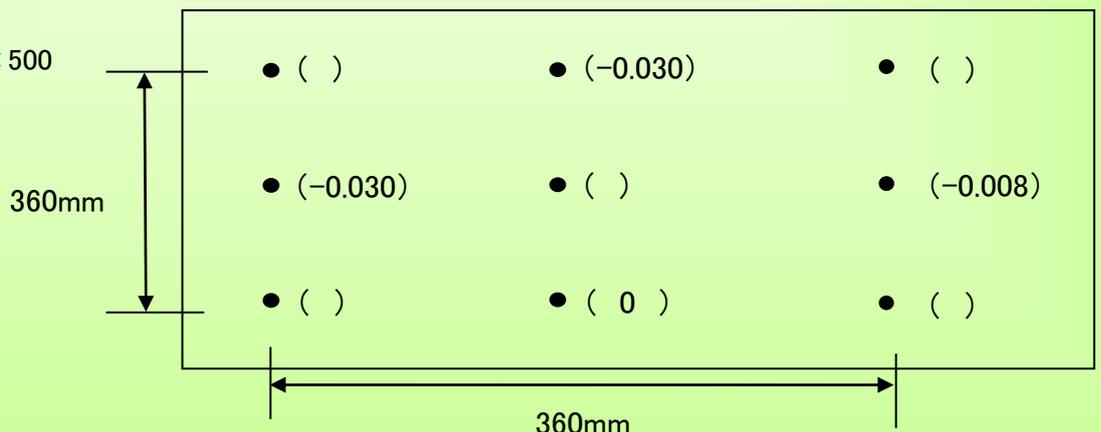

2023/7/18