


精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	ヤマザキマザック	年式	2005年	管理番号	P008114
型式	VCN-410A	測定者	野辺沼	アシスタント	

振り回し(300ピッチ)

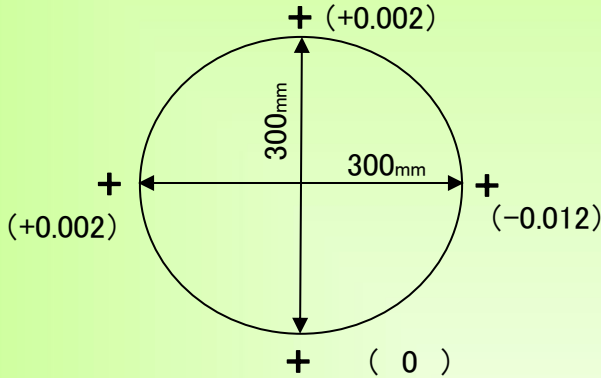

主軸振れ



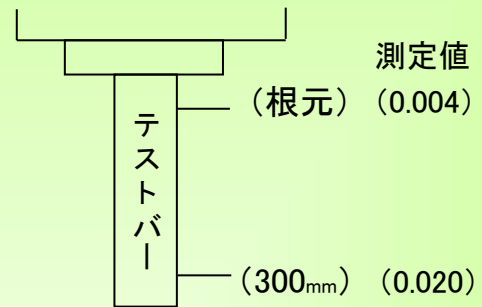


直角度

【YZ】 測定値 (0.004)

【XZ】 測定値 (0.020)


【XY】 測定値 (0.024)

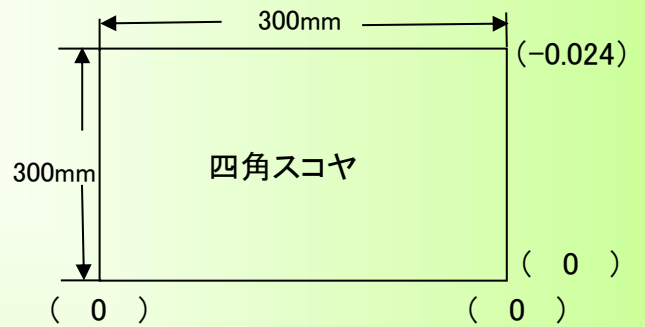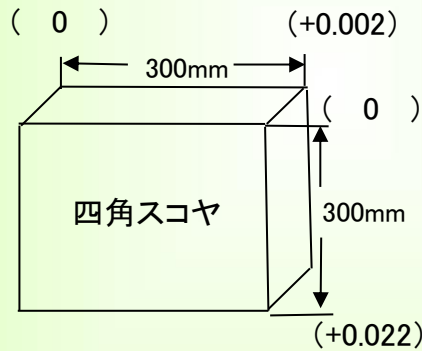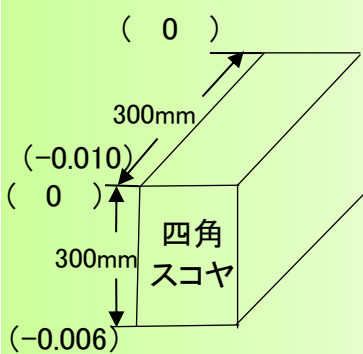

上面精度

※テーブルサイズ 900×410

- No.1
- ◆ No.2

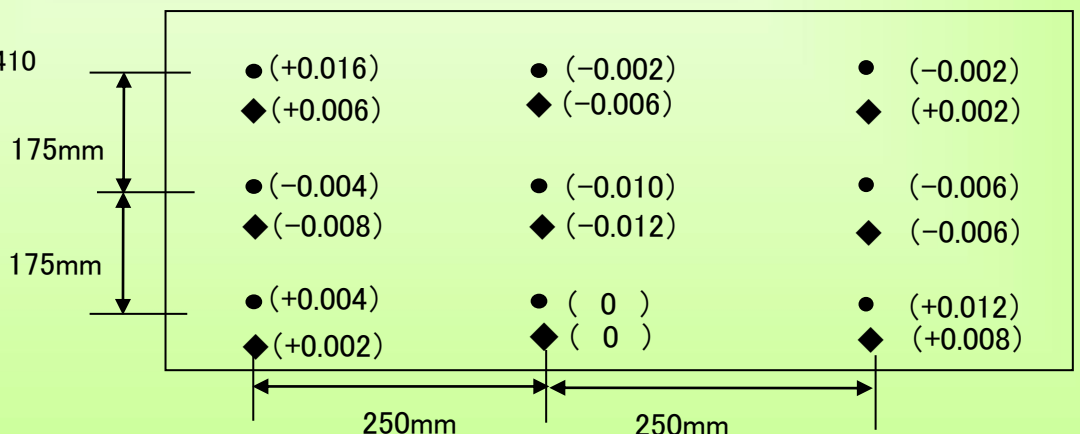

2023/9/1