# 精度測定検査表

*Examination for precision list*

| メーカー | オークマ | 年式 | 1999年製 | バーコード | P006420 |
|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | MA-40HA | 当社評価 | A | 測定者 | 平野 | アシスタント | |

## Z軸方向の平行度

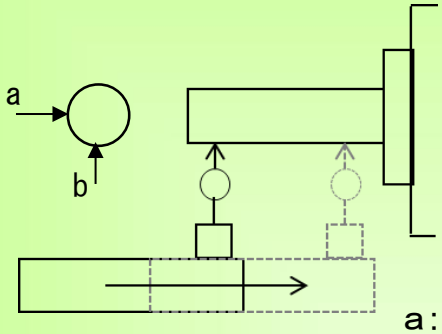


a:（ 0 ）（ 0.006 ）
b:（ 0 ）（ 0.006 ）

## 主軸振れ

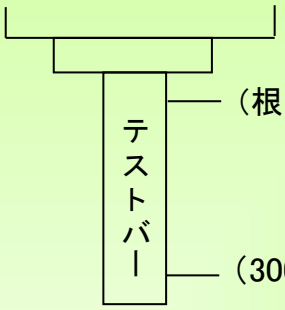


測定値

（根元）（ 0.004 ）

（300mm）（ 0.014 ）

## 直角度

【XY】測定値（ 0.008 ）

【ZY】測定値（ 0.010 ）

【ZX】測定値（ 0.006 ）

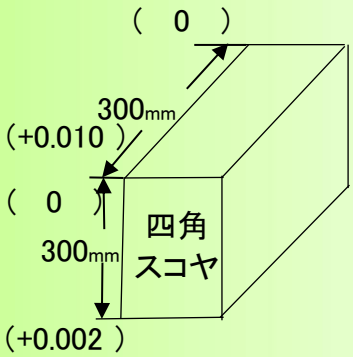


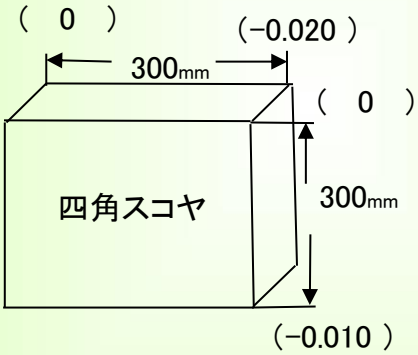

## 上面精度

ﾃｰﾌﾞﾙｻｲｽﾞ：400角
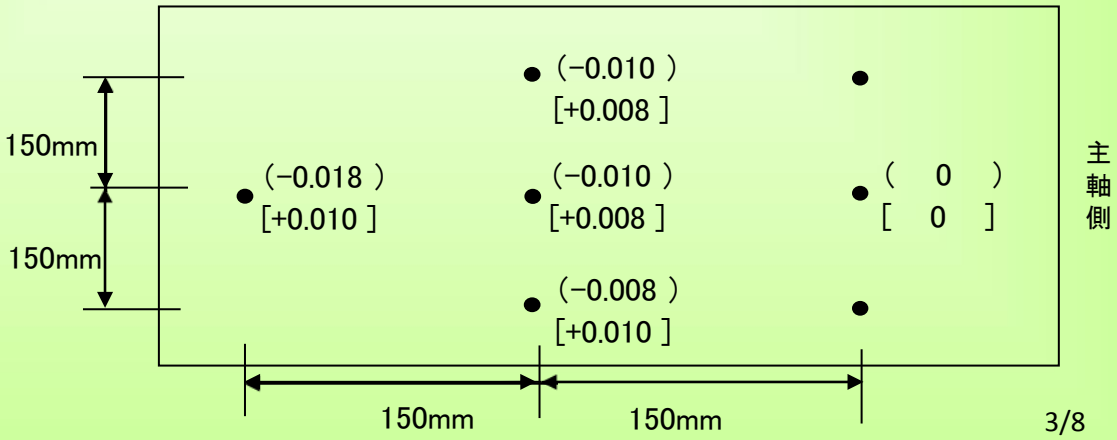
（ ）→パレット1
[ ]→パレット2