


精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	オークマ	年式	2010.12	管理番号	P008343
型式	GENOS M460-VE	測定者	金子	アシスタント	

振り回し(300ピッチ)

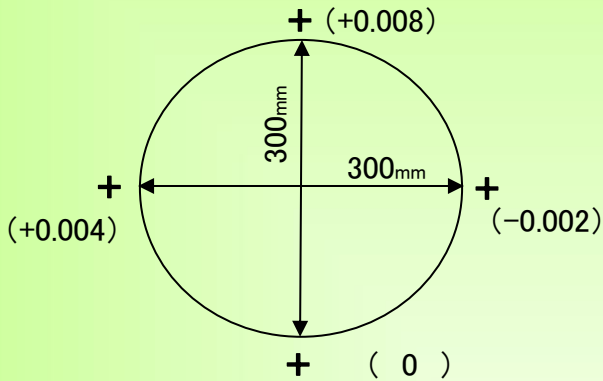

主軸振れ



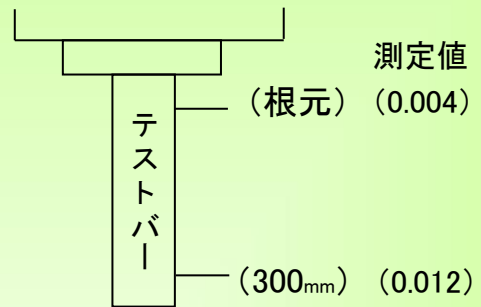


直角度

【YZ】測定値 (0.006)


【XZ】測定値 (0.002)

【XY】測定値 (0.006)

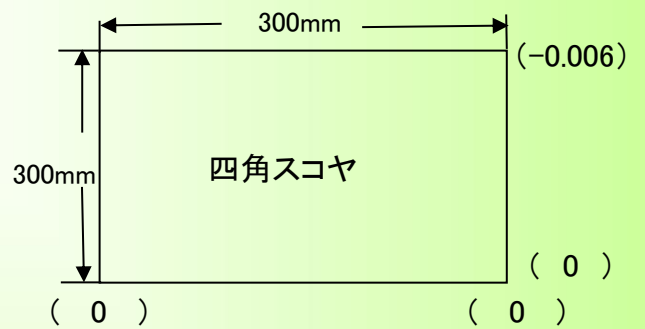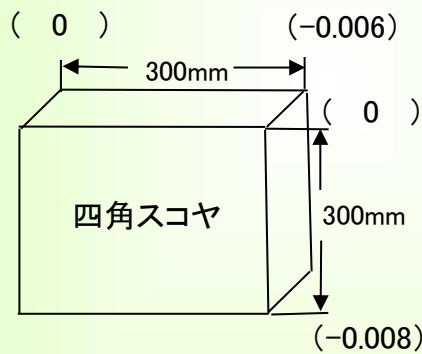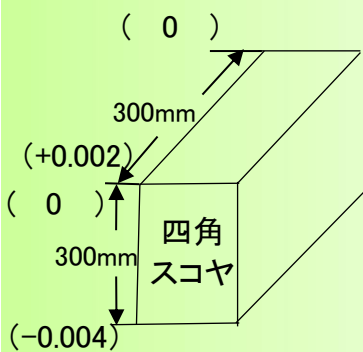

上面精度

※テーブルサイズ 1000×460

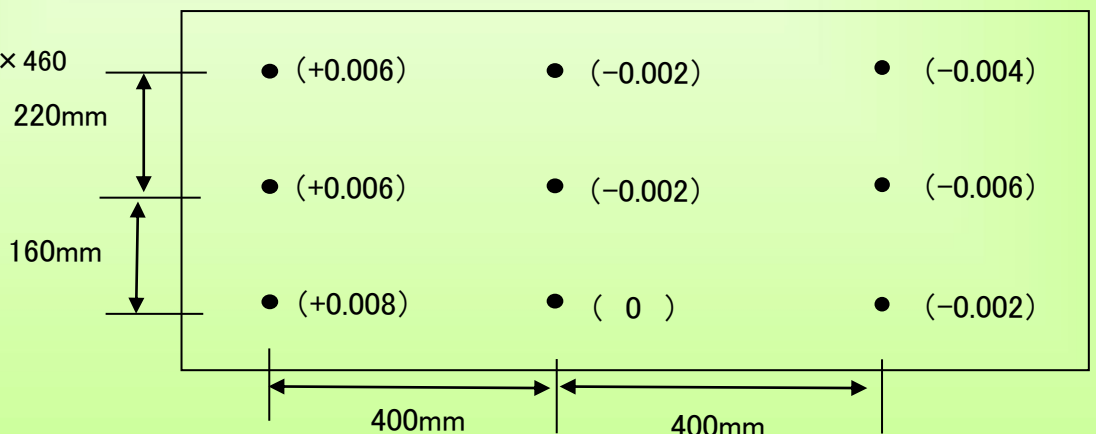

2023/9/21