精度測定検査表

Examination for precision list

メーカー	オークマ	年式	2008年製		バーコード	P006516
型式	MILLAC-852V	当社評価	A	測定者	金子	アシスタント

振り回し(300ピッチ)

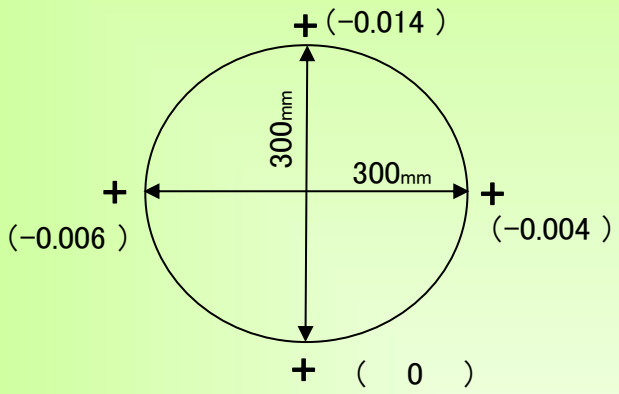

主軸振れ

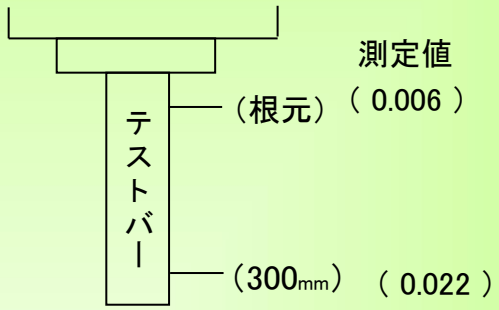

直角度

【Y Z】測定値 (0.004)　【X Z】測定値 (0.014)　【X Y】測定値 (0.004)

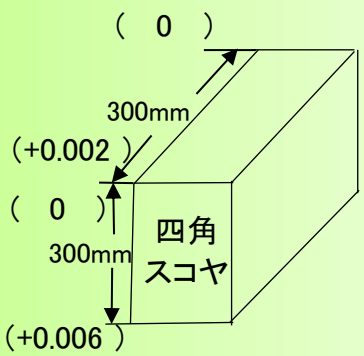

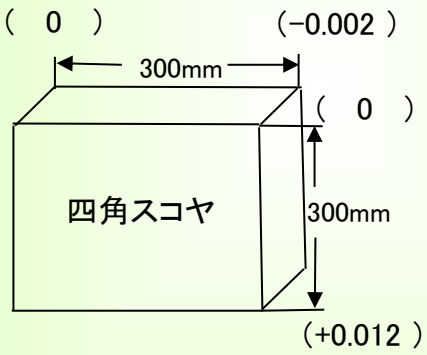

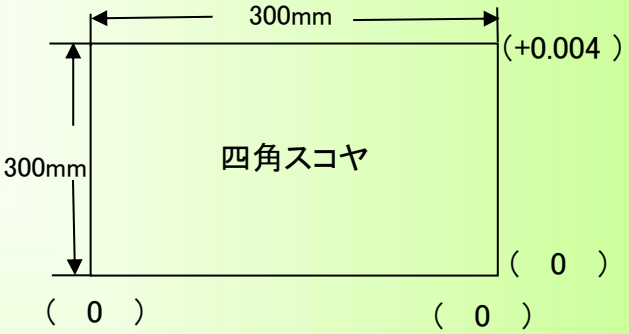

上面精度
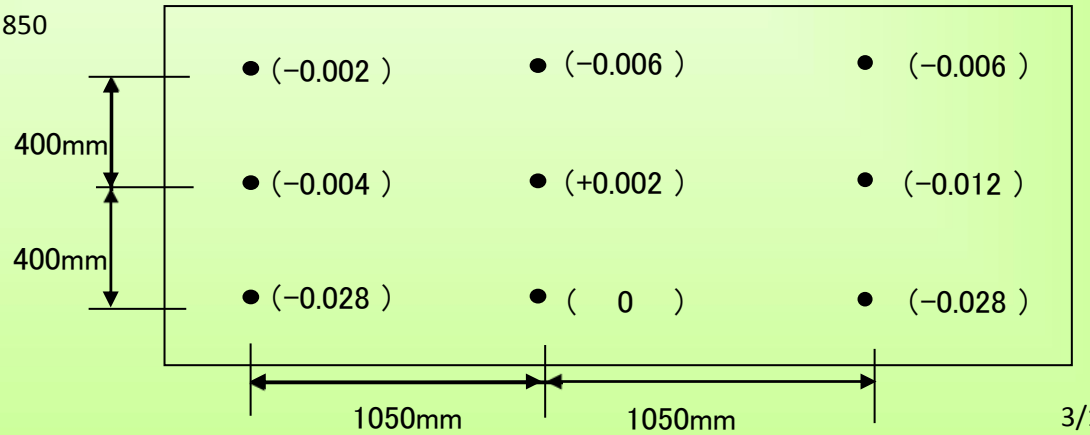
※テーブルサイズ　2200×850