


精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	ファナック	年式	2018	管理番号	P008227
型式	α -D14MiB5	測定者	近藤	アシスタント	

振り回し(200ピッチ)

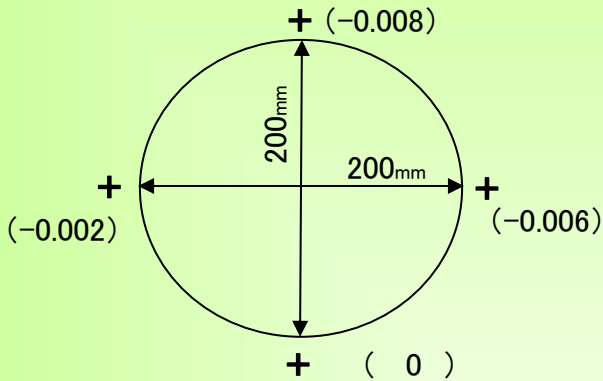

主軸振れ



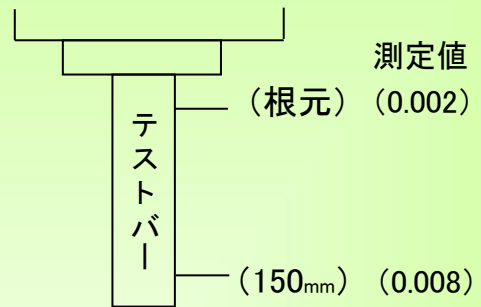


直角度

【YZ】測定値 (0.006)


【XZ】測定値 (0.018)

【XY】測定値 (0.008)

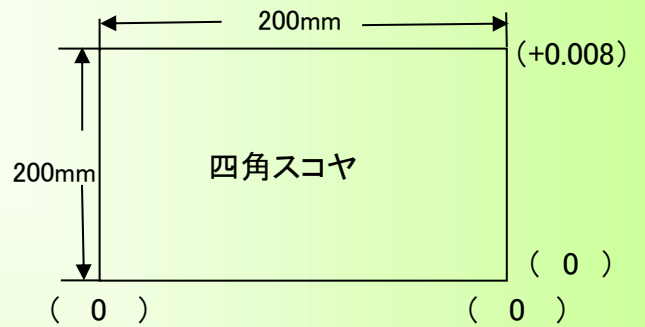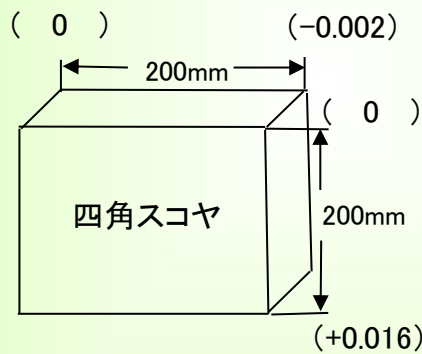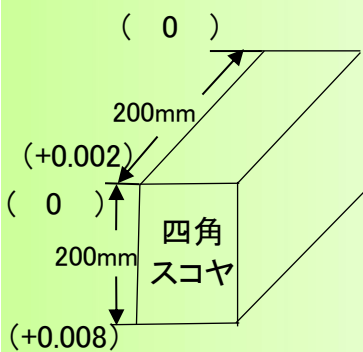

上面精度

※テーブルサイズ 650×400

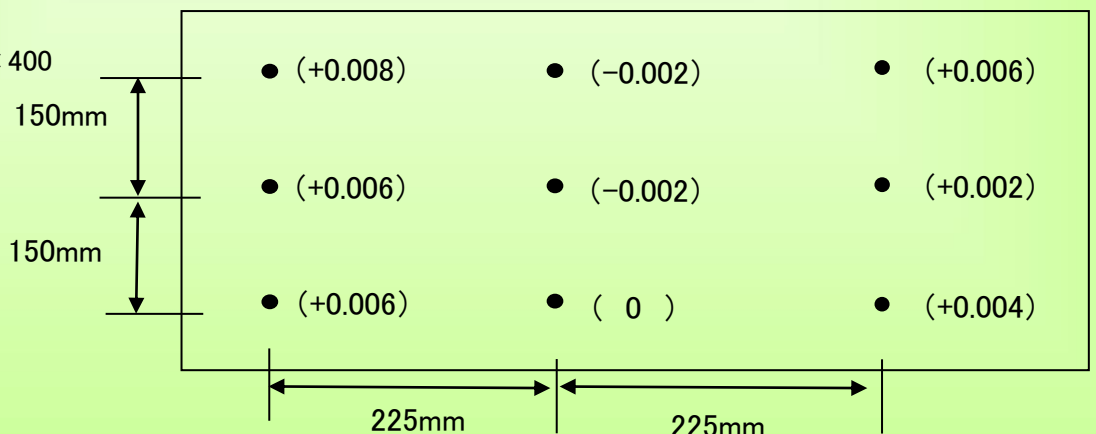

2023/11/16