


# 精度測定検査表


*Examination for precision list*

メーカー	森精機	年式	1991年製	バーコード	P006221
型式	MV-40B	当社評価	B+	測定者	奥澤 アシスタント

## 振り回し(300ピッチ)


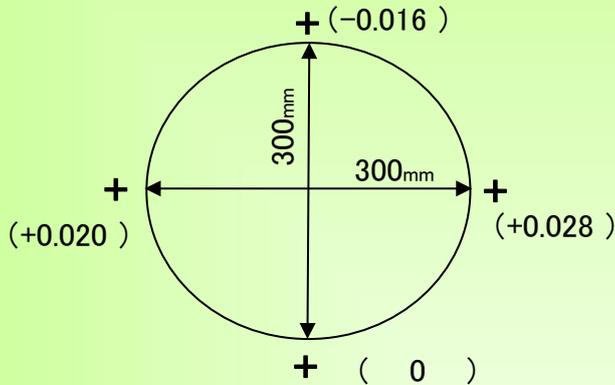


## 主軸振れ

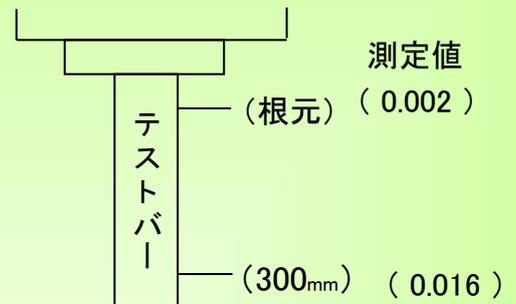

## 直角度

【Y Z】測定値 ( 0.020 )      【X Z】測定値 ( 0.018 )      【X Y】測定値 ( 0.008 )

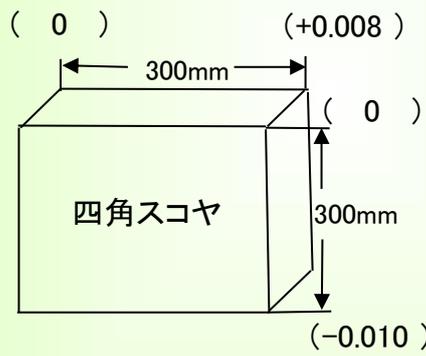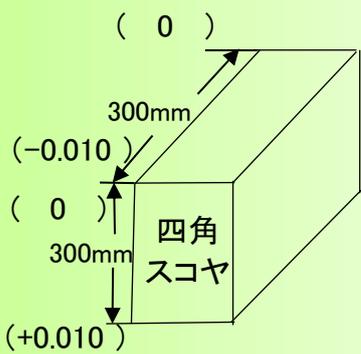

## 上面精度

※テーブルサイズ 1100 × 450

