


精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	OKK	年式	2014	管理番号	P008492
型式	VM53R	測定者	野辺 沼	アシスタント	立川

振り回し(300ピッチ)

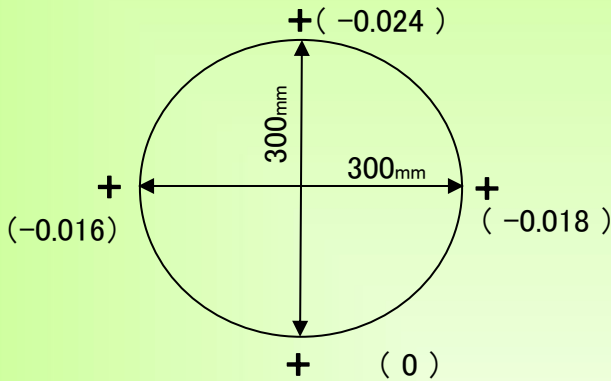

主軸振れ



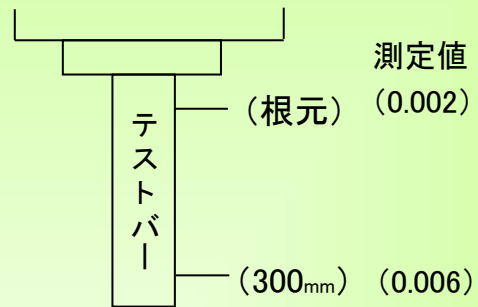


直角度

【YZ】測定値 (0.014)


【XZ】測定値 (0.010)

【XY】測定値 (0.012)

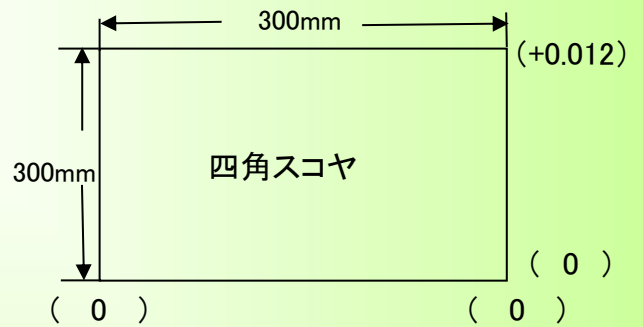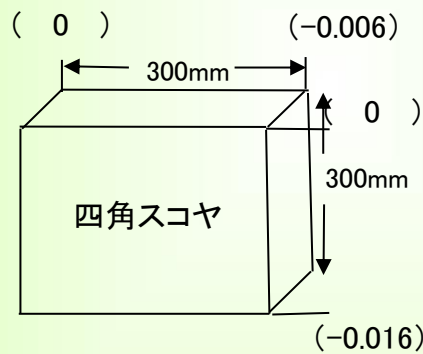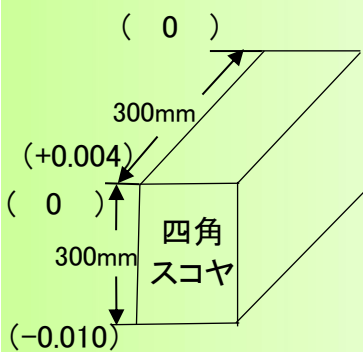

上面精度

※テーブルサイズ 1050 × 560

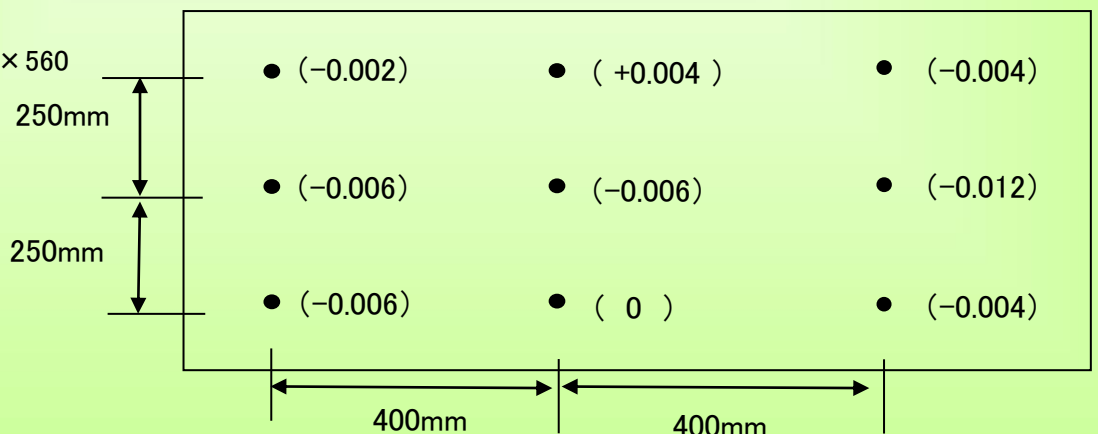

2024/3/18