


精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	ヤマザキマザック	年式	2006	管理番号	P008382
型式	VARIAXIS630-5X II	測定者	武藤	アシスタント	

振り回し(300ピッチ)

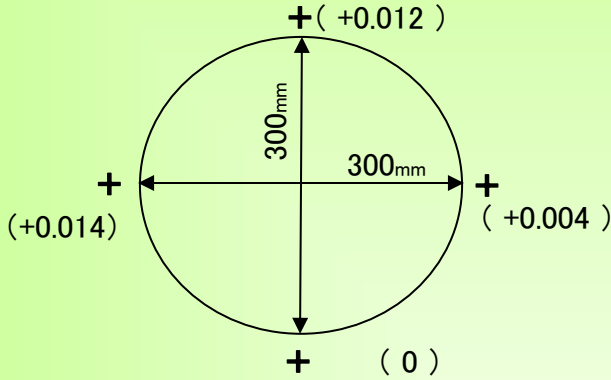

主軸振れ



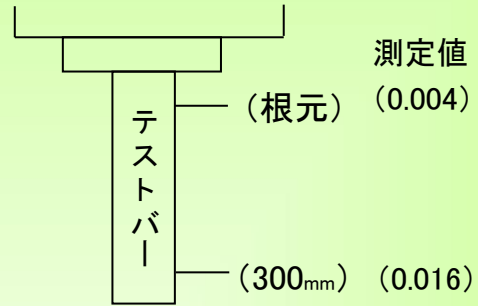


直角度

【YZ】 測定値 (0.008)

【XZ】 測定値 (0.04)


【XY】 測定値 (0.016)

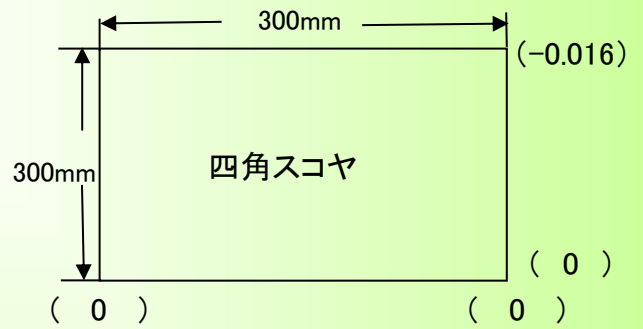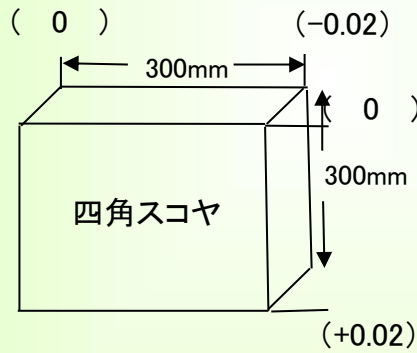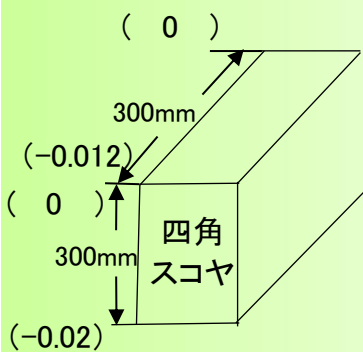

上面精度


※テーブルサイズ 500×500

テーブル90°

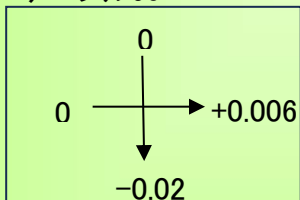

パレット1 []

パレット2 ()

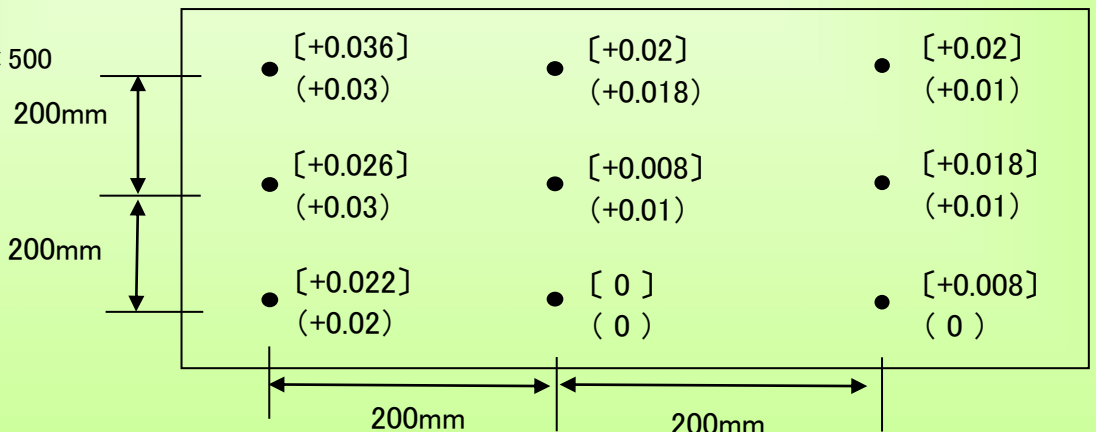

2024/4/16