精度測定検査表

Examination for precision list

メーカー	静岡鉄工	年式	2001年製	バーコード	H014363
型式	AN-SRN	当社評価		測定者		アシスタント	

振り回し(300ピッチ)

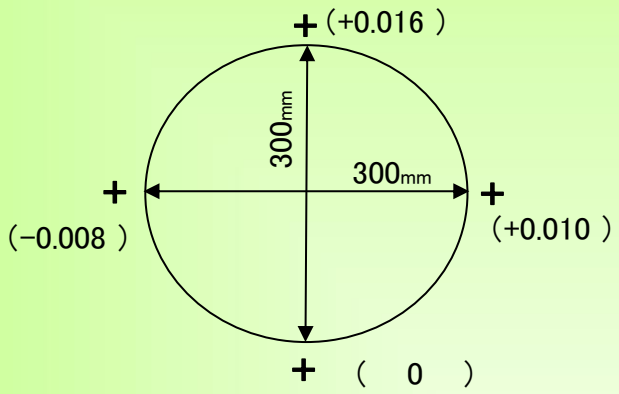

主軸振れ

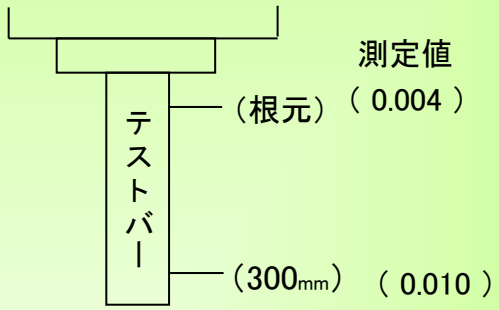

直角度

【Y Z】測定値 (0.010)　【X Z】測定値 (0.016)　【X Y】測定値 (0.006)

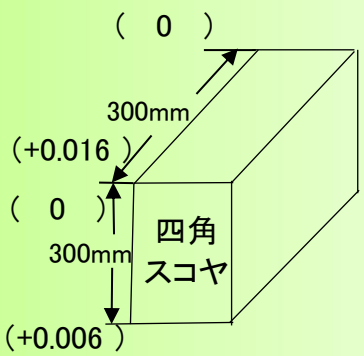

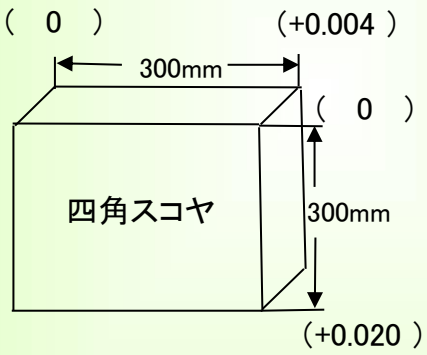

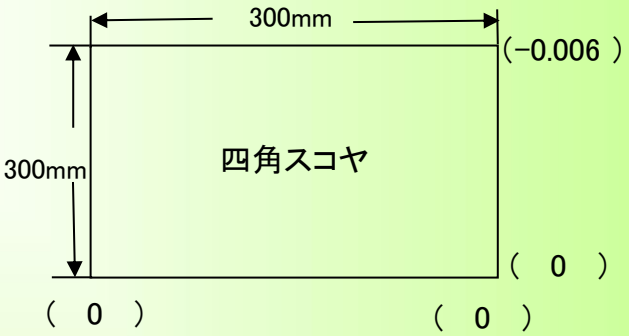

上面精度
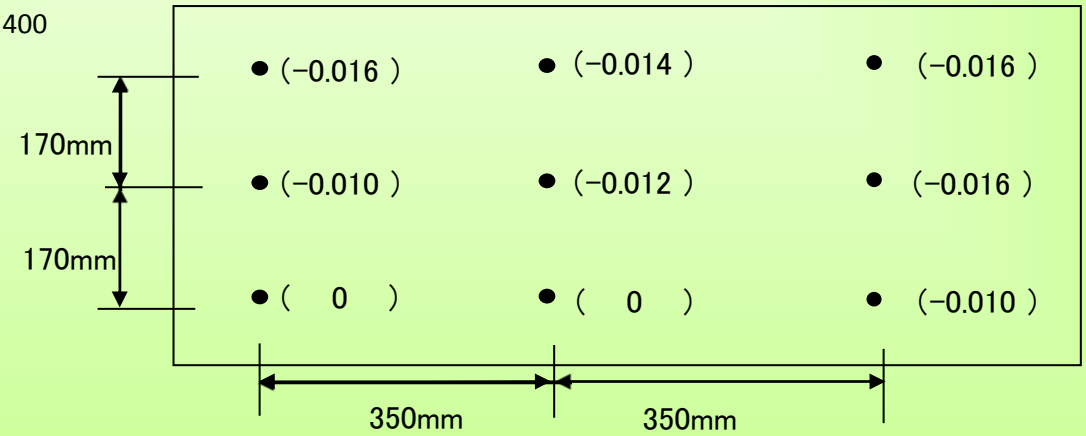
※テーブルサイズ　1100×400