


精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	森精機	年式	1997年製	バーコード	P006690
型式	MV-55/50	当社評価	A	測定者	金子・阿部

振り回し(300ピッチ)

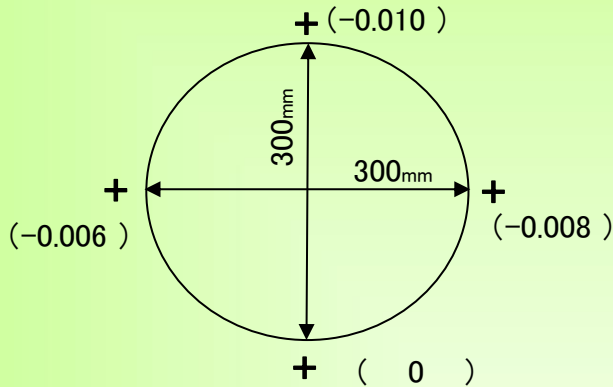




主軸振れ

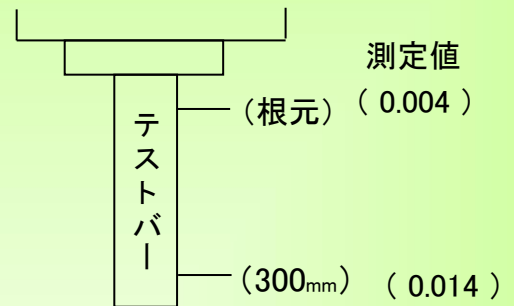

直角度

【X Z】測定値 (0.008) 【Y Z】測定値 (0.004)

【X Y】測定値 (0.004)

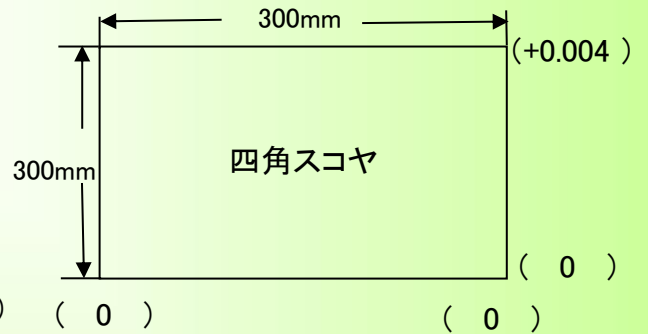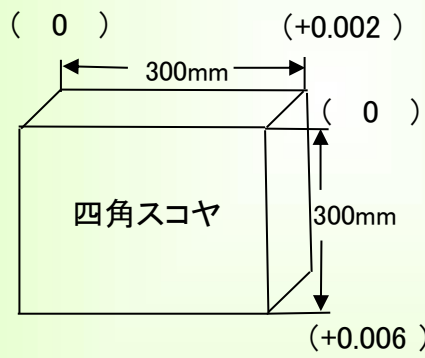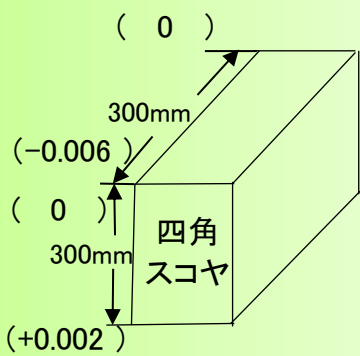

上面精度

※テーブルサイズ 1400×550

