



# 精度測定検査表

Examination for precision list

メーカー	オークマ	年式	2000年製
型式	MX-45VA	管理番号	P006619

## 振り回し(300ピッチ)

## 主軸振れ

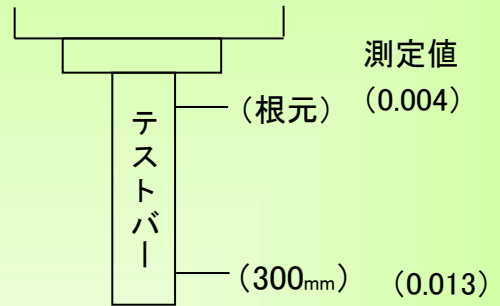
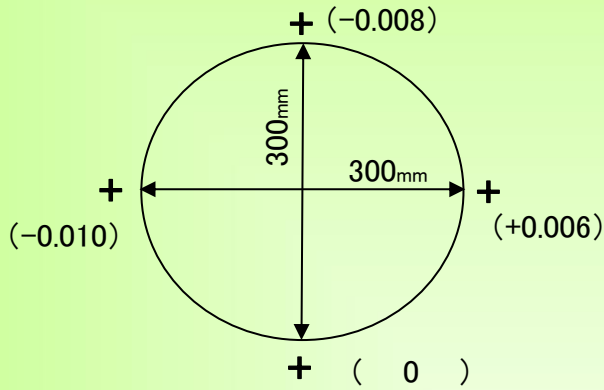


## 直角度

【YZ】測定値 (0.022)

【XZ】測定値 (0.002)

【XY】測定値 (0.018)

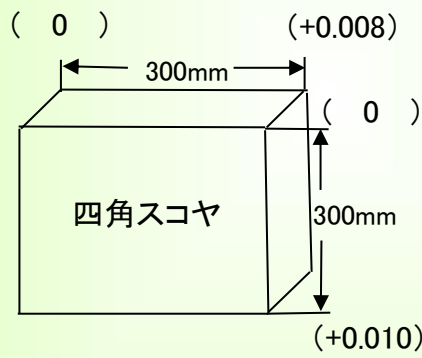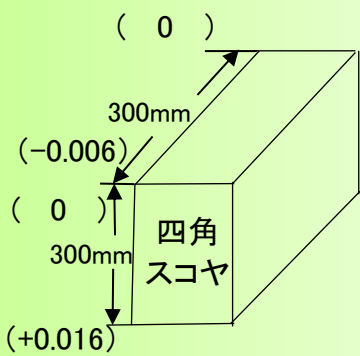

## 上面精度

※テーブルサイズ 760×460

