精度測定検査表

Examination for precision list

メーカー	大隈豊和	年式	1996年製	バーコード	P006646
型式	MILLAC-511V	当社評価		測定者	金子

振り回し（300ピッチ）

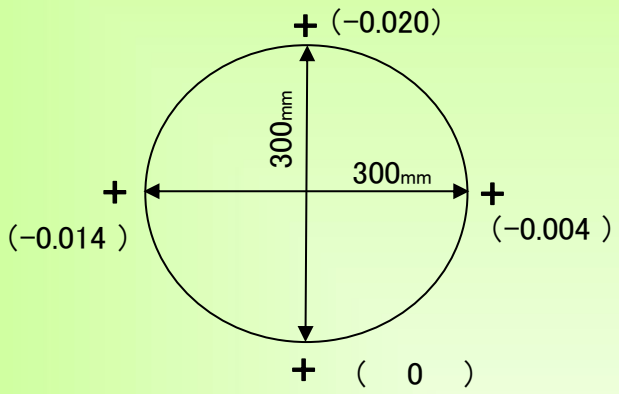

主軸振れ

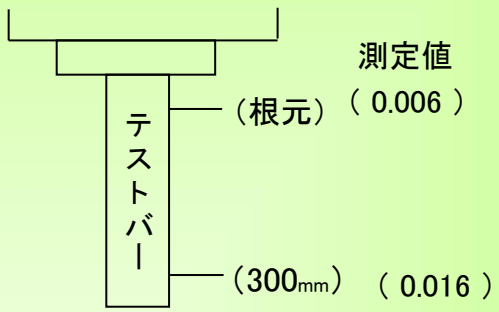

直角度

【X Z】測定値 (0.014)　【Y Z】測定値 (0.006)　【X Y】測定値 (0.016)

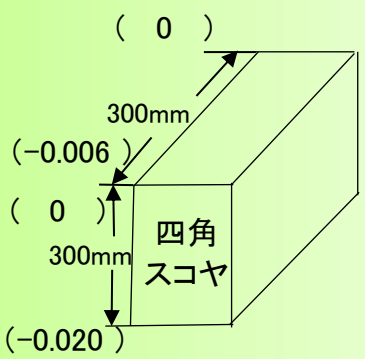

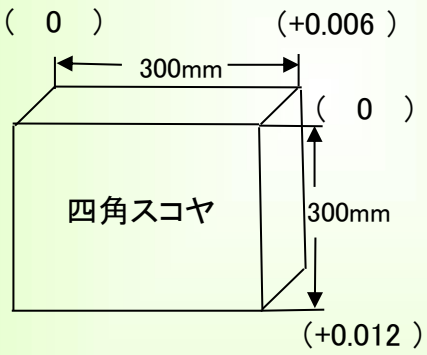

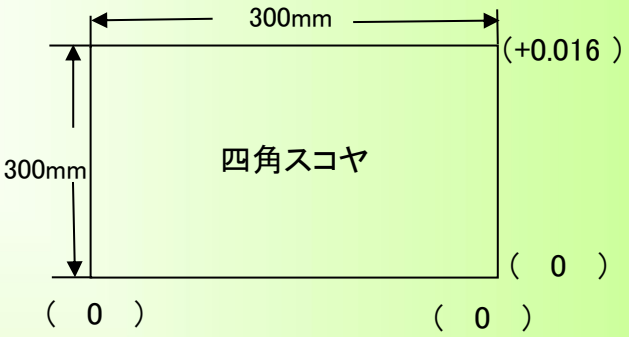

上面精度
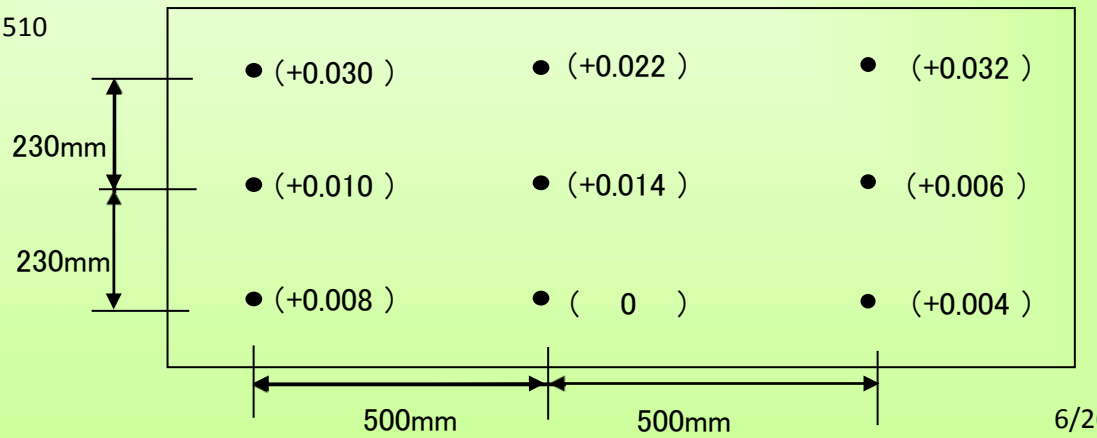
※テーブルサイズ　1270×510