



精度測定検査表

Examination for precision list

メーカー	ファナック	年式	2008年製	バーコード	P006723
型式	α -T14iFL	当社評価		測定者	金子

振り回し(300ピッチ)

主軸振れ


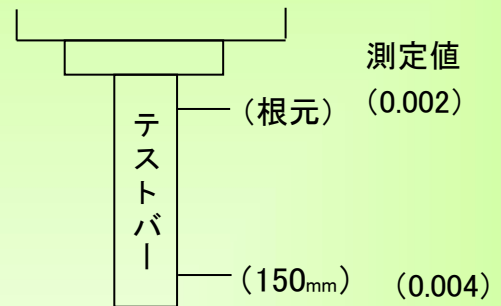
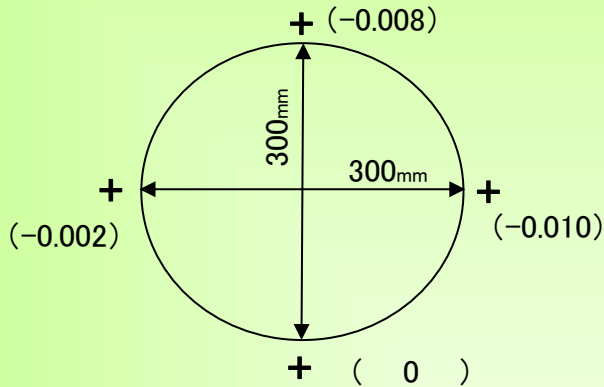


直角度

【YZ】測定値 (0.004)

【XZ】測定値 (0.004)

【XY】測定値 (0.006)

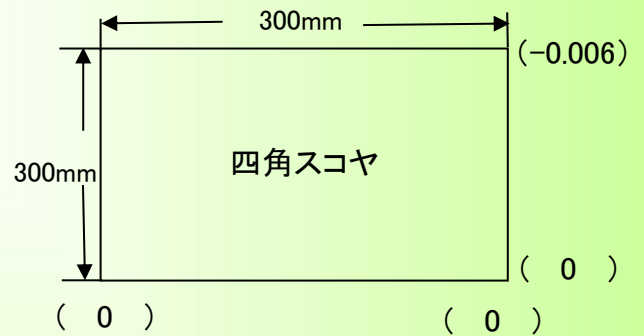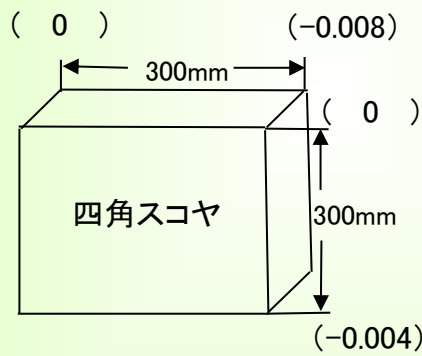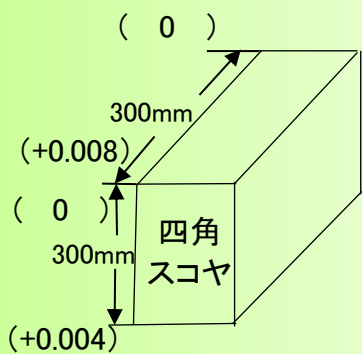

上面精度

※テーブルサイズ 850×410

