精度測定検査表

Examination for precision list

メーカー	池貝	年式	2000年製	バーコード	P006531
型式	TVU4	当社評価	B	測定者	武藤

振り回し（300ピッチ）

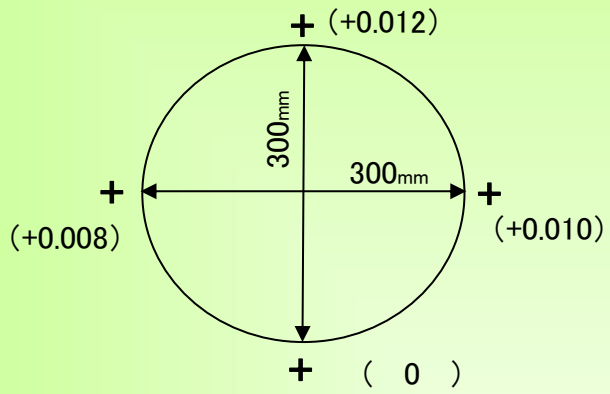

主軸振れ

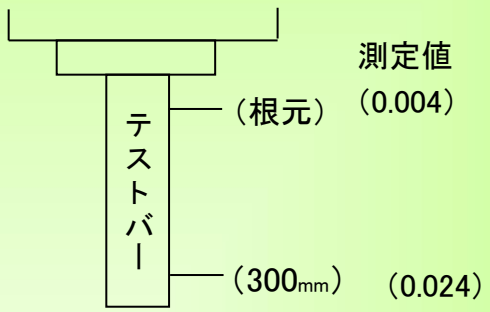

直角度

【YZ】測定値 (0.004)　【XZ】測定値 (0.018)　【X Y】測定値 (0.012)

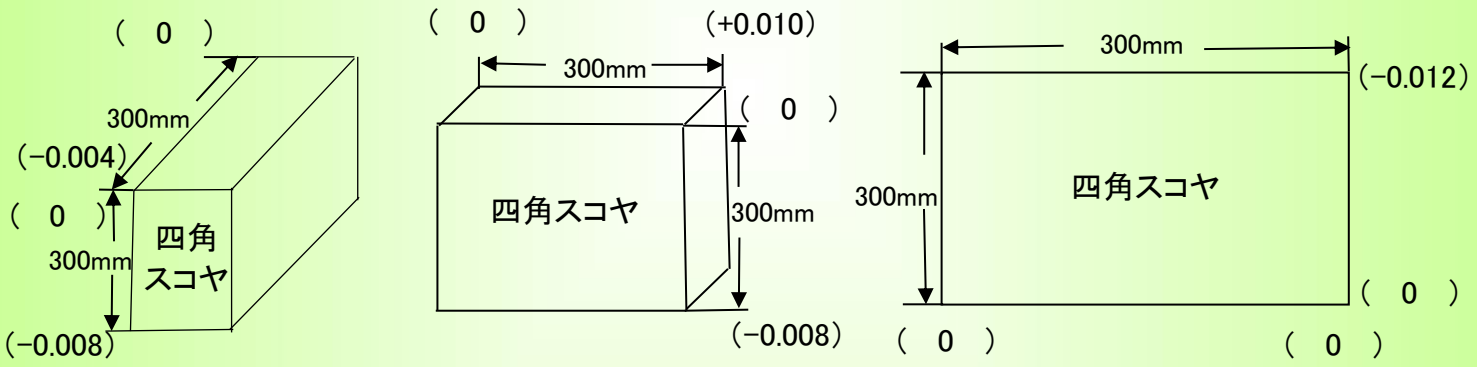

上面精度
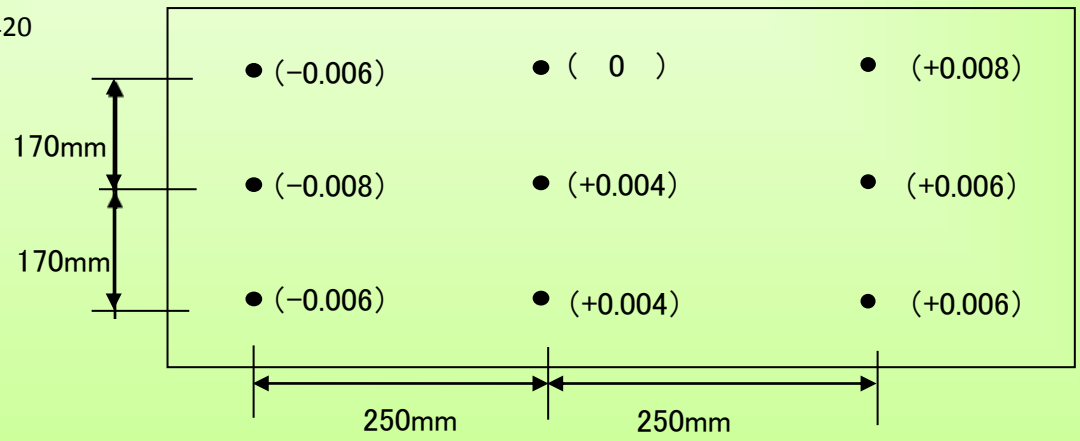
※テーブルサイズ 700×420