精度測定検査表

Examination for precision list

メーカー	ファナック	年式	2009年製	管理番号	P006755
型式	α-T14iFsa	測定者	武藤	アシスタント	

振り回し(300ピッチ)

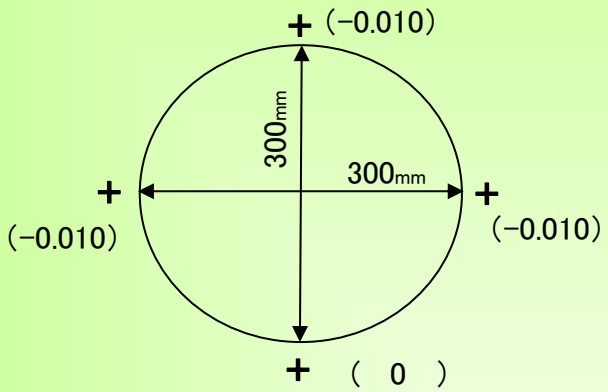

主軸振れ

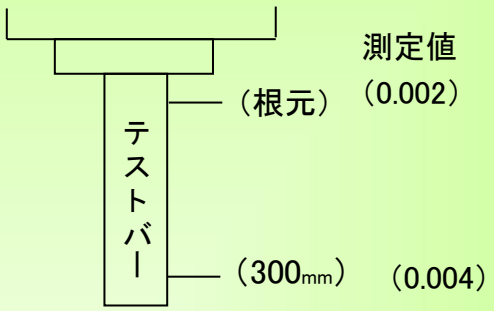

直角度

【Y Z】測定値 (0.004)

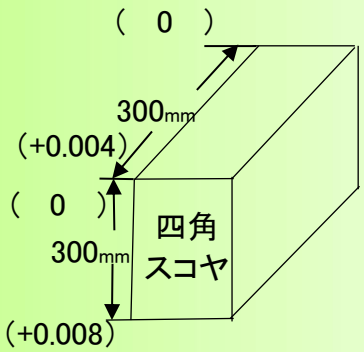

【X Z】測定値 (0.004)

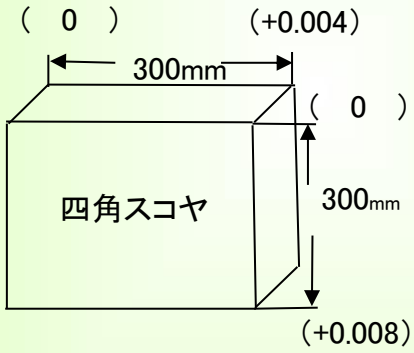

【X Y】測定値 (0.010)

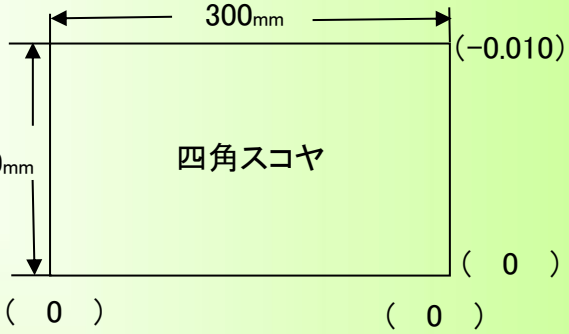

上面精度

※テーブルサイズ 630×330

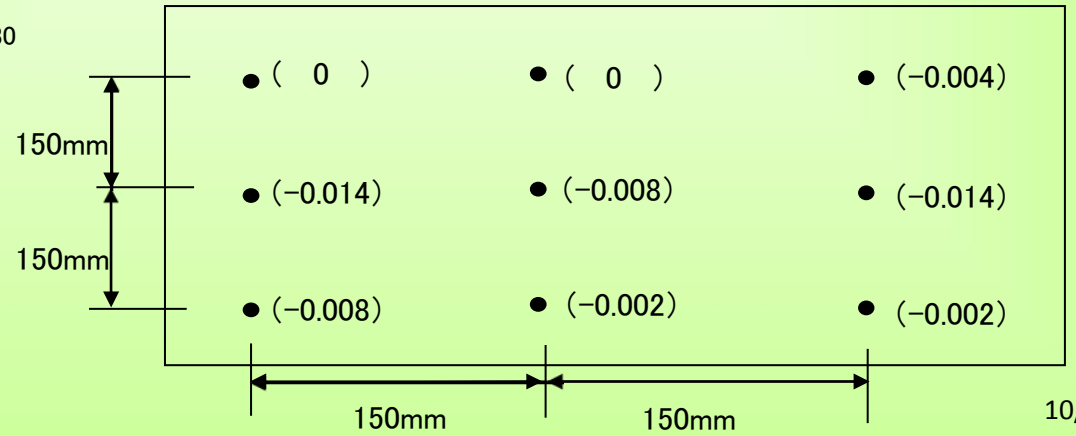

10/5