精度測定検査表

Examination for precision list

メーカー	OKK	年式	1996年製	管理番号	P006793
型式	VM4	測定者	奥澤	アシスタント	

振り回し(300ピッチ)

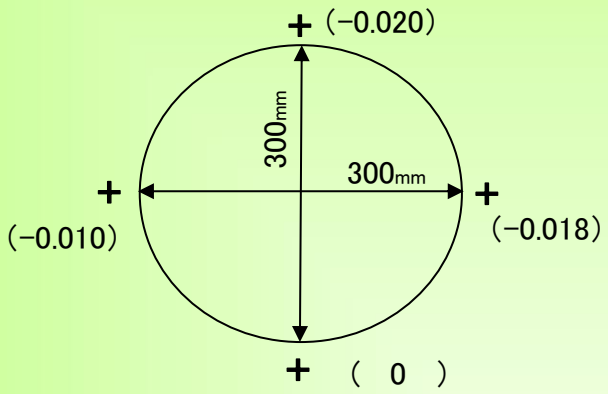

主軸振れ

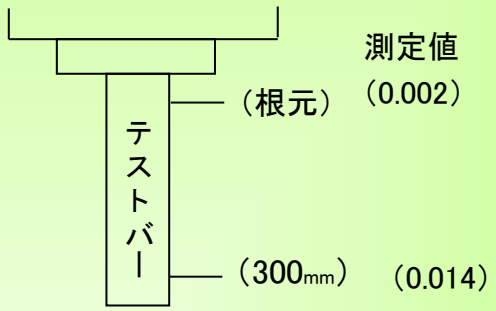

直角度

【Y Z】測定値 (0.010)

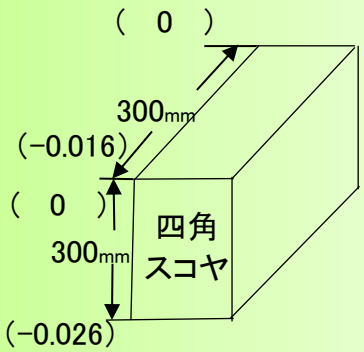

【X Z】測定値 (0.024)

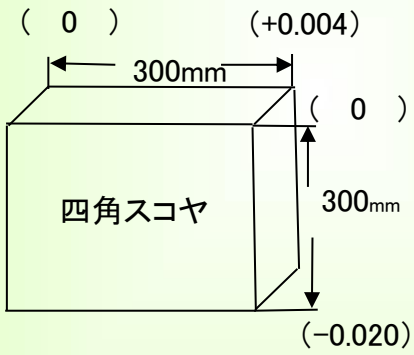

【X Y】測定値 (0.018)

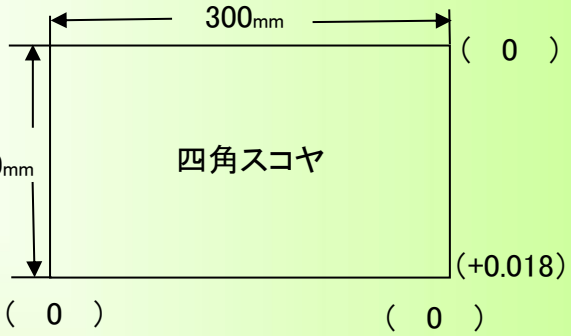

上面精度
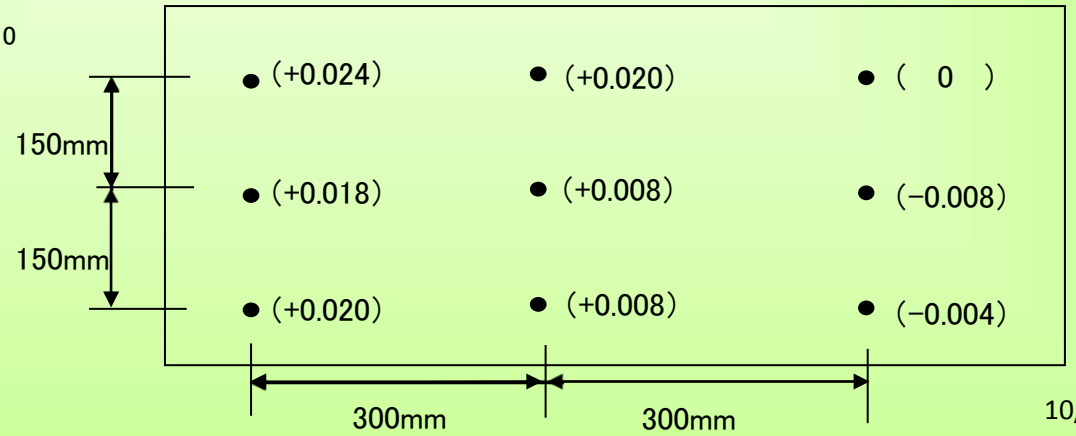
※テーブルサイズ 800×410